

SEJA VOCÊ

Be You | Seas Tu

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Product Catalog | Catalogo de Productos

2024

*Implantes Dentários
Dental Implants | Implantes Dentales*

Catálogo de Produtos | Catalogue | Catalogo



ÍNDICE

P&D | P&D

02

Linha Cone Morse | Morse Taper Line | Línea Cono Morse

18


 Sistema **Infra**[®] - Infra[®] System | Sistema Infra[®]


 Sistema **Compact**[®] - Compact[®] System | Sistema Compact[®]

 Sistema **Duocon**[®] - Duocon[®] System | Sistema Duocon[®]

Linha Hexágono Externo | Outer Hexagon Line | Línea Hexágono Externo

34

 Sistema **Ares**[®] - Ares[®] System | Sistema Ares[®]

 Sistema **Duo**[®] - Duo[®] System | Sistema Duo[®]

 Sistema **Inttegra**[®] - Inttegra[®] System | Sistema Inttegra[®]

Componentes Protéticos Digitais | Digital Prosthetic Components | Aditamentos Protésicos Digitales

50

Linha EVO | EVO Line | Línea EVO

54

 Kits e Instrumentais | Instruments and kits | Instrumentos y Kits



Encontrar a singularidade em nossa profissão é uma tarefa que alguns passam anos para completar. Em uma época em que tudo parece se resumir a clichês e cópias de fórmulas prontas, a **Signo Vinces®** novamente vai além do óbvio e se revoluciona. Não poderia ser diferente, dado o nosso histórico de mais de 20 anos desenvolvendo uma linha de produtos exclusiva que dialoga diretamente com o perfil dos nossos clientes, únicos e cheios de personalidade. Esse é mais um passo em uma longa história, de inúmeros profissionais que buscam melhorar seus tratamentos, sua qualidade de vida e suas técnicas, além de trazer mais conforto e facilidade aos seus pacientes. E nos enxergam como seus parceiros nessa trajetória. Esse é o novo momento da **Signo Vinces®**, que reafirma seu compromisso em ir além nessa fase que se apresenta, com muitas novidades e qualidade que você já conhece. Permitindo assim a manifestação de todo o seu talento, profissionalismo e singularidade que só a **#Signo** entende.

*Encontrar singularidad en nuestra profesión es una tarea que algunos de nosotros llevamos años completando. En un momento en que todo parece reducido a clichés y copias de fórmulas rápidas, **Signo Vinces®** vuelve a ir más allá de lo obvio y se revoluciona a sí mismo. No podría ser diferente, dada nuestra trayectoria de más de 20 años desarrollando una línea exclusiva de productos que habla directamente al perfil de nuestros clientes, únicos y ricos en personalidad. Este es un paso más en una larga trayectoria de innumerables profesionales que buscan mejorar sus tratamientos, su calidad de vida y sus técnicas, además de crear más comodidad y tranquilidad para sus pacientes. Y nos ven como sus socios en este viaje. Este es el nuevo momento de **Signo Vinces®** que reafirma su compromiso de ir más allá de esta etapa, con muchas novedades y cualidades que ya conoces. Permitiendo así la manifestación de todo su talento, profesionalismo y singularidad que solo **#Signo** entiende.*

*Finding singularity in our profession is a task that take years to accomplish. At a moment, when everything seems to boil down to clichés and copies of ready-made formulas, **Signo Vinces®** once again goes beyond the obvious and revolutionizes itself. It couldn't have been different, given our history of more than 20 years developing an exclusive product line that goes in par with our customers profile, unique and full of personality. This is another step in a long history of countless professionals who seek to improve their treatments, their quality of life and their techniques, in addition to bringing more comfort and ease to their patients. We are their partners in this journey. This is a new moment for **Signo Vinces®**, reassuring its commitment to go beyond, in the new era that presents itself, with many updates and quality that you already know. Thus, allowing the manifestation of all your talent, professionalism and uniqueness that only **#Signo** understands.*

VALORES VALUES · VALORES

Desenvolver o potencial de cada colaborador nas relações humanas e na técnica de desenvolvimento e fabricação dos produtos, preparando a equipe não só para o conhecimento nos processos, mas também criando valores.

Developing the potential of each employee in human relations, technical development and manufacturing of products, preparing the team not only to be knowledgeable about the processes, but also creating value.

El desarrollo del potencial de cada empleado en las relaciones humanas y en el desarrollo técnico así como la fabricación de productos, la preparación del equipo no sólo al conocimiento de los procesos, sino que también para agregar valor.

POLÍTICA DE QUALIDADE QUALITY POLICY · POLÍTICA DE CALIDAD

"Temos como Política de Qualidade satisfazer as necessidades dos nossos clientes, melhorando continuamente os processos, atendendo os requisitos aplicáveis, qualificando nossos colaboradores e disponibilizando novas soluções que permitam aos clientes ampliar suas possibilidades de aperfeiçoarem o seu trabalho."

"Our Quality Policy is to meet the needs of our clients, continuously improving processes, meeting applicable requirements, qualifying our employees and offering new solutions that allow our clients to expand their ability to improve their work."

"Nuestra Política de Calidad es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mejorando continuamente los procesos, cumpliendo con los requisitos aplicables, calificando a nuestros empleados y brindando nuevas soluciones que permitan a los clientes ampliar sus posibilidades para mejorar su trabajo".



Há 24 anos a **Signo Vinces®** investe em tecnologia e desenvolvimento de produtos inovadores, para proporcionar aos seus clientes uma nova forma de fazer o seu trabalho, com ganho de tempo, garantia de resultado e visão de futuro.

Com você a Signo é muito mais!

*For 24 years, Signo Vinces® has invested in technology and the development of innovative products, to provide its customers with a new way of doing their work, saving time, guaranteeing results and a vision of the future.
With you, Signo is much more!*

*En 24 años, Signo Vinces® ha invertido en tecnología y en el desarrollo de productos innovadores, para brindar a sus clientes una nueva forma de hacer su trabajo, ahorro de tiempo, resultados garantizados y visión de futuro.
¡Contigo, Signo es mucho más!*



SALA LIMPA CLEAN ROOM · SALA LIMPIA

A sala limpa foi projetada para atender plenamente às exigências fiscais da saúde, adotando como protocolo a embalagem dos implantes em capela ISO 5 (classe 100) e dos componentes em ISO 7 (classe 10.000).

The clean room was projected to fully comply with Health Department regulations, and adopts ISO 5 (Class 100) protocol for implant packaging in laminar flow chamber, and ISO 7 (class 10.000) for components.

Se ha concebido la sala limpia para atender plenamente a las exigencias en materia sanitaria, adoptando como protocolo el envase de los implantes en una campana de flujo laminar ISO 5 (clase 100) y de los componentes en ISO 7 clase 10.000).

Certificações

Certifications · Certificaciones

RDC 665/2022|ANVISA

Boas Práticas de Fabricação.

Buenas Practicas de Manufactura.

Good Manufacturing Practices.

EN ISO 13485:2016

***Medical Devices - Quality Management Systems
Requirements for Regulatory Purposes***




Superfície Vellox®

A Superfície Vellox® é desenvolvida nos mais rígidos padrões internacionais de processo, resultando em uma resposta segura e previsível à osseointegração dos implantes **Signo Vinces®**.

Tratada por processo físico-químico de subtração, por meio de jato abrasivo e tratamentos ácidos, que condicionam a superfície e proporcionam uma porosidade ideal para aumentar a área de contato com o tecido ósseo.

Os Implantes **Signo Vinces®** apresentam uma excelente integridade superficial, todo o tratamento físicoquímico garante uma superfície livre de quaisquer contaminantes que possam interferir no processo de formação óssea.

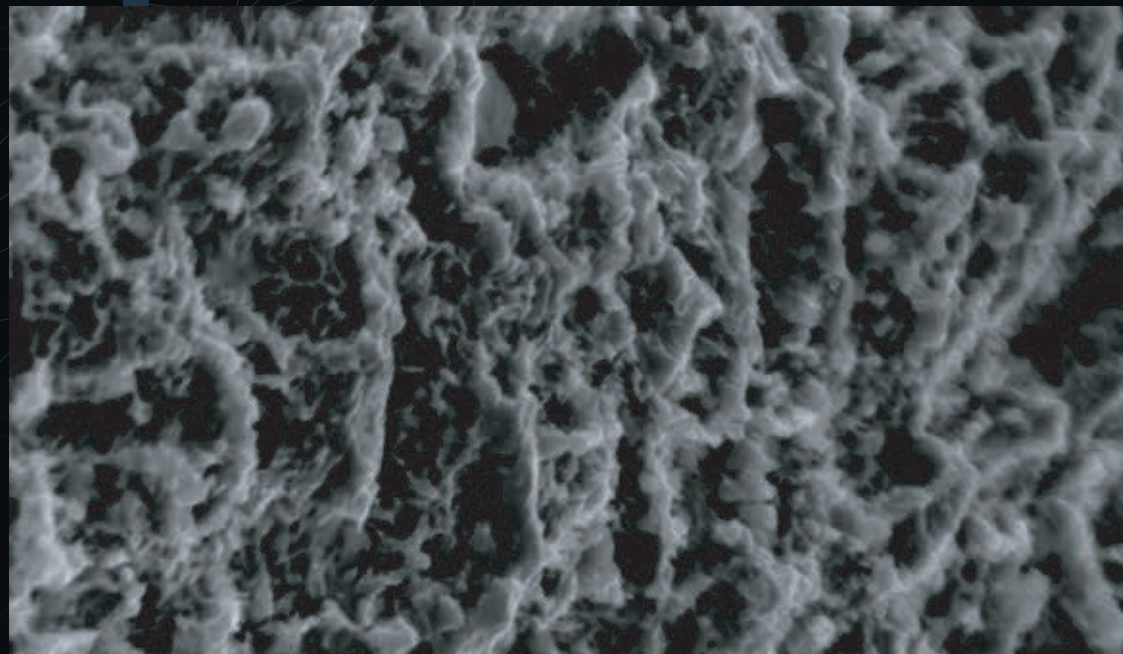

Vellox Surface® is developed to meet the highest international process standards, resulting in a safe and predictable response for bone integration around all Signo Vinces® dental implants.

Treated with physical-chemical subtraction processes, with abrasive "sand blast" and acid etched treatment. These treatments condition the surface and offer ideal porosity to increase contact area with bone tissue.


Signo Vinces® Implants offer great surface integration, and the entire physical-chemical treatment guarantees a surface free of any contaminants that might interfere with the bone formation process.

Se desarrolló a la superficie Vellox® en los más rígidos estándares internacionales de procesos, que resultó en una respuesta segura y predecible de integración ósea de los implantes Signo Vinces®.

Tratada por proceso físico-químico de sustracción, por medio de un chorro abrasivo y tratamientos ácidos, que condicionan la superficie y proporcionan una porosidad ideal al aumento del área de contacto con el tejido óseo.

Los implantes Signo Vinces® presentan una excelente integridad superficial; todo el tratamiento físico-químico garantiza una superficie libre de cualquier contaminante que pueda interferir en el proceso de formación ósea.

FOTOMICROGRAFIA PHOTOMICROGRAPHY · FOTOMICROGRAFÍA

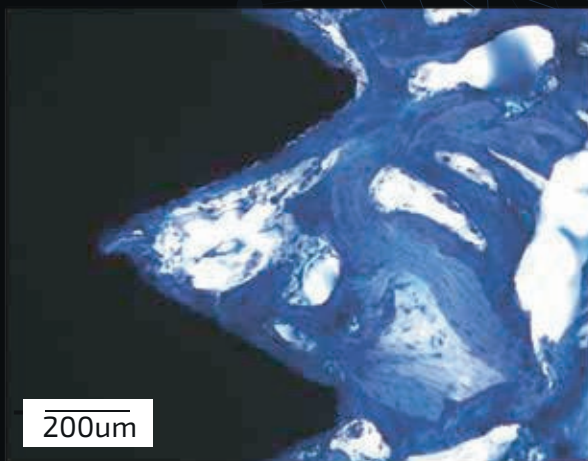

Fotomicrografia demonstrando a íntima relação entre osso e superfície duplamente tratada após três semanas in vivo em osso trabeculado em tíbia de cães.


Photomicrography demonstrating the intimate relation between bone and treated surface after three weeks in vivo in the trabecular bone in the tibia of a dog.

Fotomicrografía que muestra la íntima relación entre el hueso y la superficie doblemente tratada tras tres semanas "in vivo" en hueso trabeculado en tibia de perros.

Biocompatibilidade e osseocondutividade da Superfície Vellox[®] proporcionando alto grau de contato osso-implante, garantindo a rápida estabilização biomecânica do implante.

Biocompatibility and bone conductivity of the Vellox surface allows for a high degree of bone-implant contact, guaranteeing high biomechanical stabilization of the implant.


Biocompatibilidad y conductividad ósea de la superficie Vellox[®] proporcionan un alto grado de contacto hueso-implante, asegurándole la rápida estabilización biomecánica del implante.

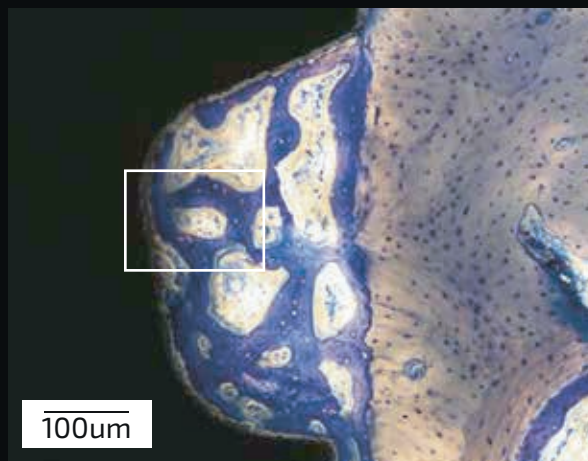

Demonstração do rápido preenchimento ósseo ao longo da estrutura do implante resultando em uma rápida osseointegração.

Demonstration of the rapid filling in of the bone tissue along the implant structure resulting in high bone integration.

Demostración del rápido llenado ósseo a lo largo de la estructura del implante que resulta en una rápida integración ósea.

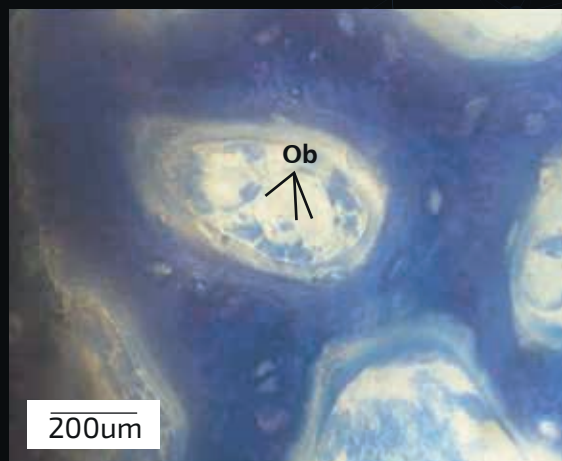

Em detalhe, fotomicrografia demonstrando a presença de osteoblastos na câmara de coágulo.

In detail, photomicrography of the region close to the implant surface, showing the presence of living and active osteoblasts.

En detalle, fotomicrografía de la región cerca de la superficie que muestra la presencia de osteoblastos.

EXPERIÊNCIA + FUNCIONALIDADE + DESIGN + TECNOLOGIA + PERFORMANCE

Todos os produtos Signo Vinces® foram idealizados pensando na experiência do cliente.

Começando pela embalagem, que foi desenvolvida para oferecer maior praticidade e segurança aos produtos, garantindo a sua integridade até chegar às mãos do profissional que irá utilizá-lo.

O investimento no design e na tecnologia também são pontos importantes na apresentação dos implantes Signo Vinces®, além da performance, fundamental para o sucesso dos casos clínicos.

EXPERIENCE + FUNCTIONALITY + DESIGN + TECHNOLOGY + PERFORMANCE


All Signo Vinces® products were designed with the customer's experience in mind.

Investment in design and technology are also important points in the presentation of Signo Vinces® implants, in addition to performance.

EXPERIENCIA + FUNCIONALIDAD + DESIGN + TECNOLOGÍA + RENDIMIENTO

Todos los productos de Signo Vinces® se diseñaron pensando en la experiencia del cliente. Comenzando por el empaque, que fue desarrollado para ofrecer mayor practicidad y seguridad a los productos, asegurando su integridad hasta llegar a las manos del profesional que lo utilizará.

La inversión en design y tecnología también son puntos importantes en la presentación de los implantes Signo Vinces®, además del rendimiento, que es fundamental para el éxito de los casos clínicos.

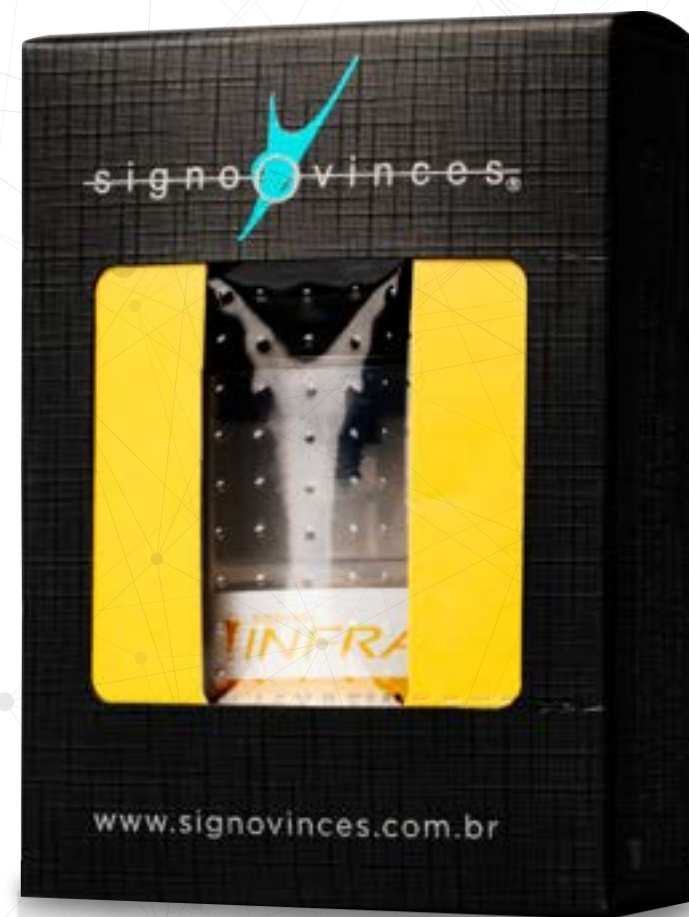

1



Após a abertura da selagem de esterilidade do blister, você terá acesso à cápsula estéril (embalagem primária). Empurre a tampa para cima e terá a embalagem primária aberta para capturar o implante, e posteriormente, o Tapa Implante.

After opening the blister's sterility seal, you will have access to the sterile capsule (primary packaging). Push the cap up and you will have the primary packaging open to capture the implant, and then the implant cap.

Tras la apertura del sellado de esterilidad del blister, tendrás acceso a la cápsula estéril (empaquete primario). Presione a la tapa para hacia y lo gará abrir el empaque primario para capturar el implante, y posteriormente, su tapa implante.

2



Capture o implante com a Chave de Captura.

Capture the implant with the Capture Driver.

Capture el implante con la Llave de Captura.

3



Capture o Tapa Implante com a Chave Digital Sextavada.

Capture the implant cover screw with the Digital Hexagonal Wrench.

Capture el tapa implante con la Llave Digital Sextavada.

IMPLANTE IMPLANT · IMPLANTE



Interface Protética

Prosthetic Interface
Interfaz Protésico

<p>CM compact, duocon & infra</p>			<p>HE ares, duo & integra</p>		


Rosca

Threads
Rosca

trapezoidal trapezoidal trapezoidal	cervical cervical trapezoidal trapezoidal	trapezoidal trapezoidal trapezoidal	trapezoidal trapezoidal trapezoidal	trapezoidal trapezoidal trapezoidal	cervical cervical triangular triangular trapezoidal trapezoidal
CILÍNDRICO CYLINDRICAL · CILINDRICO	CÔNICO CONICAL · CÔNICO		CÔNICO CONICAL · CÔNICO	CÔNICO CONICAL · CÔNICO	CILÍNDRICO CYLINDRICAL · CILINDRICO

Ápice

Apex · Ápice

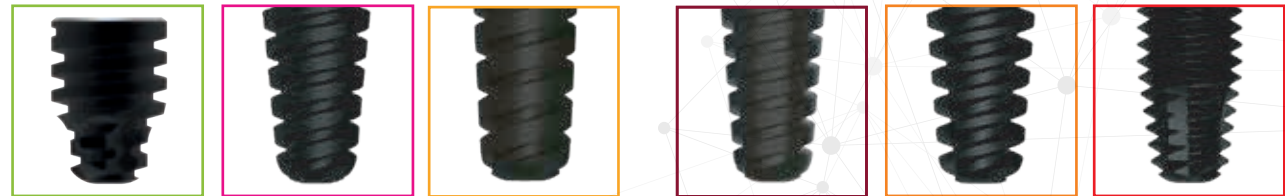

INDICAÇÃO DE OSSO

BONE INDICATION · INDICACIÓN DEL HUESO



TIPO I

TYPE I · TIPO I



. Torque máximo recomendável: 45N.cm Recommended max torque: 45N.cm | Torque máximo recomendable: 45N.cm



TIPO II

TYPE II · TIPO II



. Torque máximo recomendável: 45N.cm Recommended max torque: 45N.cm | Torque máximo recomendable: 45N.cm



TIPO III

TYPE III · TIPO III



. Torque máximo recomendável: 45N.cm Recommended max torque: 45N.cm | Torque máximo recomendable: 45N.cm



TIPO IV

TYPE IV · TIPO IV



. Torque máximo recomendável: 45N.cm Recommended max torque: 45N.cm | Torque máximo recomendable: 45N.cm

* Osso com deficiência em altura Height deficient bone · Hueso con deficiencia en altura

INSTALAÇÃO DO IMPLANTE · IMPLANT INSTALLATION · INSTALACIÓN DEL IMPLANTE

1

BROCA LANÇA HELICOIDAL
HELICOIDAL POINTED START DRILL
FRESA LANZA HELICOIDAL


2

BROCA HELICOIDAL 2.6MM
HELICOIDAL DRILL 2.6MM
FRESA HELICOIDAL 2.6MM

3

BROCA COUNTERSINK 3.3-2.6MM
COUNTERSINK DRILL 3.3-2.6MM
FRESA COUNTERSINK 3.3-2.6MM

IMPLANTE INTEGRA 3.25MM
INTEGRA IMPLANT 3.25MM
IMPLANTE INTEGRA 3.25MM

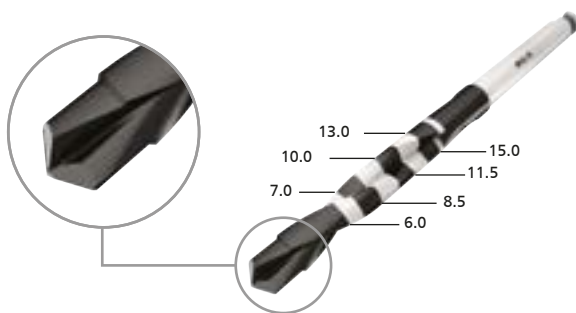

■ BROCA LANÇA HELICOIDAL HELICOIDAL POINTED START DRILL FRESA LANZA HELICOIDAL
● BROCA HELICOIDAL HELICOIDAL DRILL FRESA HELICOIDAL
■ BROCA COUNTERSINK COUNTERSINK DRILL FRESA COUNTERSINK

Ø 3.25 mm	2.0 ■	2.6 ●	3.3 ■			
Ø 3.75 mm	2.0 ■	2.6 ●		3.0 ●		4.1 ■
Ø 4.00 mm	2.0 ■	2.6 ●		3.0 ●	3.3 ●	4.1 ■
Ø 5.00 mm	2.0 ■	2.6 ●		3.0 ●	3.3 ●	3.8 ● 4.3 ● 5.0 ■

* Considerando a utilização de contra-ângulo reductor 16:1/20:1/ 27:1 e motor elétrico compatível.
 **As chaves de instalação do implante com conexão para contra-ângulo não devem ultrapassar o torque de 35N/cm.
 **As chaves de instalação do implante com conexão para torquímetro não devem ultrapassar o torque de 45N/cm.
 * Considering the use of 16:1/20:1/27:1 contra-angle reducer and compatible with the drilling motor.
 ** The implant installation drivers with contra-angle connection should not exceed of torque 35N/cm.
 ** The implant installation wrenches with torque wrench connection must not exceed 45N/cm.
 * Considering the utilización del contra-ángulo reductor 16:1/20:1/ 27:1 y motor eléctrico compatible.
 **Las llaves de instalación del implante con conexión para contra-ángulo no debe superar el giro de 35N/cm.
 **Las llaves de instalación del implante con conexión para torque no debe superar el giro de 45N/cm.

INTEGRA 3.25MM

lança ▶ helicoidal ▶ countersink 3.3
Ø2.0 Ø2.6

INTEGRA 3.75MM

lança ▶ helicoidal ▶ Ø3.0 ▶ countersink 4.1
Ø2.0 Ø2.6

INTEGRA 4.00MM

lança ▶ helicoidal ▶ Ø3.0 ▶ Ø3.3 ▶ countersink 4.1
Ø2.0 Ø2.6


INTEGRA 5.00MM

lança ▶ helicoidal ▶ Ø3.0 ▶ Ø3.3 ▶ Ø3.8 ▶ Ø4.3 ▶ countersink 5.0
Ø2.0 Ø2.6

INSTALAÇÃO DO IMPLANTE · IMPLANT INSTALLATION · INSTALACIÓN DEL IMPLANTE



1		2		3		4		5		6			
	BROCA LANÇA HELICOIDAL HELICOIDAL POINTED START DRILL FRESA LANÇA HELICOIDAL		BROCA HELICOIDAL 2.6MM HELICOIDAL DRILL 2.6MM FRESA HELICOIDAL 2.6MM		BROCA HELICOIDAL 3.0MM HELICOIDAL DRILL 3.0MM FRESA HELICOIDAL 3.0MM		BROCA HELICOIDAL 3.3MM HELICOIDAL DRILL 3.3MM FRESA HELICOIDAL 3.3MM		BROCA HELICOIDAL 3.8MM HELICOIDAL DRILL 3.8MM FRESA HELICOIDAL 3.8MM		BROCA HELICOIDAL 4.3MM HELICOIDAL DRILL 4.3MM FRESA HELICOIDAL 4.3MM		IMPLANTE COMPACT 4.5MM COMPACT IMPLANT 4.5MM IMPLANTE COMPACT 4.5MM

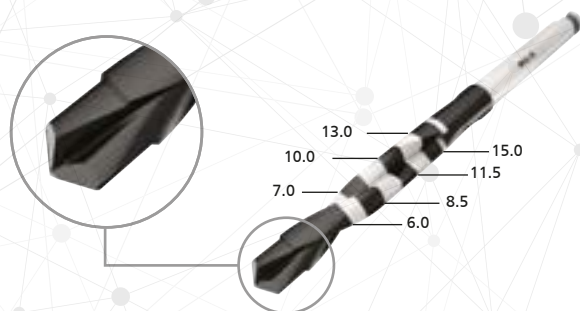



■	BROCA LANÇA HELICOIDAL HELICOIDAL POINTED START DRILL FRESA LANÇA HELICOIDAL	●	BROCA HELICOIDAL HELICOIDAL DRILL FRESA HELICOIDAL			
Ø 4.5 mm	2.0 ■	2.6 ●	3.0 ●	3.3 ●	3.8 ●	4.3 ●

COMPACT 4.5MM



- * Considerando a utilização de contra-ângulo redutor 16:1/20:1/ 27:1 e motor elétrico compatível.
- **As chaves de instalação do implante com conexão para contra-ângulo não devem ultrapassar o torque de 35N/cm.
- **As chaves de instalação do implante com conexão para torquímetro não devem ultrapassar o torque de 45N/cm.
- * Considering the use of 16: 1/20: 1/27: 1 contra-angle reducer and compatible with the drilling motor.
- ** The implant installation drivers with contra-angle connection should not exceed the of torque 35N/cm.
- ** The implant installation wrenches with torque wrench connection must not exceed 45N/cm.
- * Considerando la utilización del contra-ângulo reductor 16:1/20:1/ 27:1 y motor eléctrico compatible.
- **Las llaves de instalación del implante con conexión para contra-ângulo no debe superar el giro de 35N/cm.
- **Las llaves de instalación del implante con conexión para torque no deben superar el giro de 45N/cm.

INSTALAÇÃO DO IMPLANTE · IMPLANT INSTALLATION · INSTALACIÓN DEL IMPLANTE

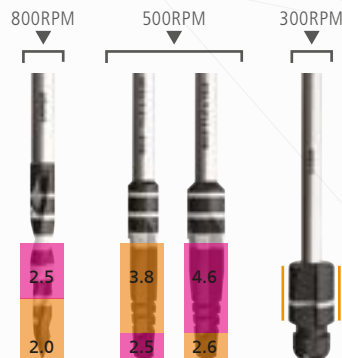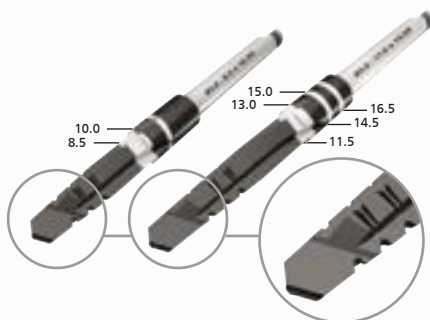

■ BROCA LANÇA HELICOIDAL
HELICOIDAL POINTED START DRILL
FRESA LANZA HELICOIDAL

● BROCA SISTEMA DUO
DUO SYSTEM DRILL
FRESA SISTEMA DUO

■ BROCA SISTEMA DUO-DUOCON
DUO-DUOCON SYSTEM DRILL
FRESA SISTEMA DUO-DUOCON

Ø 3.8 mm	2.0 ■	3.8 ●	*3.8 ■		
Ø 4.6 mm	2.0 ■	3.8 ●		4.6 ●	*4.6 ■


* Considerando a utilização de contra-ângulo reductor 16:1/20:1/ 27:1 e motor elétrico compatível.
 **As chaves de instalação do implante com conexão para contra-ângulo não devem ultrapassar o torque de 35N/cm.
 ***As chaves de instalação do implante com conexão para torquímetro não devem ultrapassar o torque de 45N/cm.
 * Considering the use of 16: 1/20: 1/27: 1 contra-angle reducer and compatible with the drilling motor.
 ** The implant installation drivers with contra-angle connection should not exceed the of torque 35N/cm.
 *** The implant installation wrenches with torque wrench connection must not exceed 45N/cm.
 * Considerando la utilización del contra-ángulo reductor 16:1/20:1/ 27:1 y motor eléctrico compatible.
 ** Las llaves de instalación del implante con conexión para contra-ángulo no debe superar el giro de 35N/cm.
 *** Las llaves de instalación del implante con conexión para torque no debe superar el giro de 45N/cm.

ARES 3.8MM



lança ▶ sist. duo ▶ countersink 3.8
ø2.0 ø3.8 obrigatório
osso tipo I e II

ARES 4.6MM

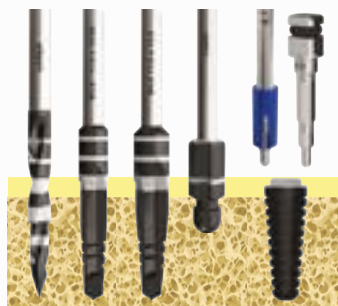

lança ▶ sist. duo ▶ ø4.6 ▶ countersink 4.6
ø2.0 ø3.8 obrigatório
osso tipo I e II


INSTALAÇÃO DO IMPLANTE · IMPLANT INSTALLATION · INSTALACIÓN DEL IMPLANTE




1
BROCA LANÇA HELICOIDAL
HELICOIDAL POINTED START DRILL
FRESA LANZA HELICOIDAL




2
BROCA SISTEMA DUO 3.8MM
DUO SYSTEM DRILL 3.8MM
FRESA SISTEMA DUO 3.8MM





3
BROCA SISTEMA DUO 4.6MM
DUO SYSTEM DRILL 4.6MM
FRESA SISTEMA DUO 4.6MM



4
BROCA SISTEMA DUO-DUOCON 4.6MM
DUO-DUOCON SYSTEM DRILL 4.6MM
FRESA SISTEMA DUO-DUOCON 4.6MM



IMPLANTE DUO 4.6MM
DUO IMPLANT 4.6MM
IMPLANTE DUO 4.6MM

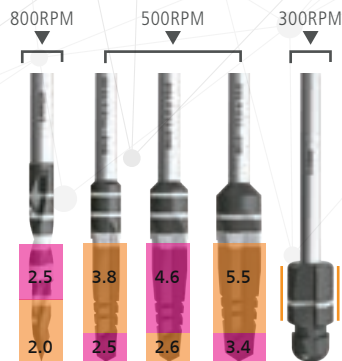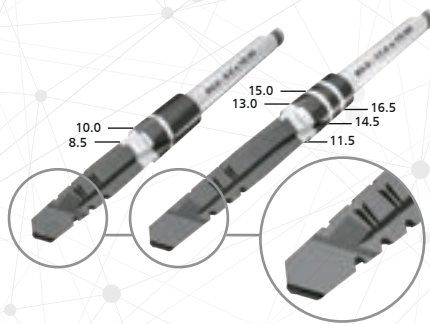

■ BROCA LANÇA HELICOIDAL HELICOIDAL POINTED START DRILL FRESA LANZA HELICOIDAL
● BROCA SISTEMA DUO DUO SYSTEM DRILL FRESA SISTEMA DUO
■ BROCA SISTEMA DUO-DUOCON DUO-DUOCON SYSTEM DRILL FRESA SISTEMA DUO-DUOCON

Ø 3.8 mm	2.0 ■	3.8 ●	*3.8 ■			
Ø 4.6 mm	2.0 ■	3.8 ●		4.6 ●	*4.6 ■	
Ø 5.5 mm	2.0 ■	3.8 ●		4.6 ●		5.5 ● *5.5 ■


* Considerando a utilização de contra-ângulo redutor 16:1/20:1/ 27:1 e motor elétrico compatível.
 ** As chaves de instalação do implante com conexão para contra-ângulo não devem ultrapassar o torque de 35N/cm.
 ** As chaves de instalação do implante com conexão para torquímetro não devem ultrapassar o torque de 45N/cm.
 * Considering the use of 16: 1/20: 1/27: 1 contra-angle reducer and compatible with the drilling motor.
 ** The implant installation drivers with contra-angle connection should not exceed the of torque 35N/cm.
 ** The implant installation wrenches with torque wrench connection must not exceed 45N/cm.
 * Considerando la utilización del contra-ángulo reductor 16:1/20:1/ 27:1 y motor eléctrico compatible.
 ** Las llaves de instalación del implante con conexión para contra-ángulo no debe superar el giro de 35N/cm.
 ** Las llaves de instalación del implante con conexión para torque no debe superar el giro de 45N/cm.

DUO 3.8MM




lança ▶ sist. duo ▶ countersink 3.8 obrigatório osso tipo I e II
ø2.0 ø3.8

DUO 4.6MM

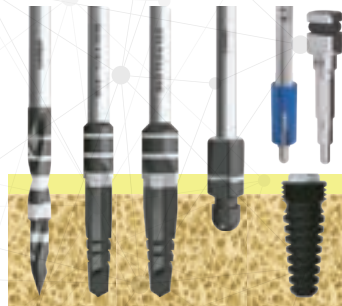

lança ▶ sist. duo ▶ ø4.6 ▶ countersink 4.6 obrigatório osso tipo I e II
ø2.0 ø3.8

DUO 5.5MM

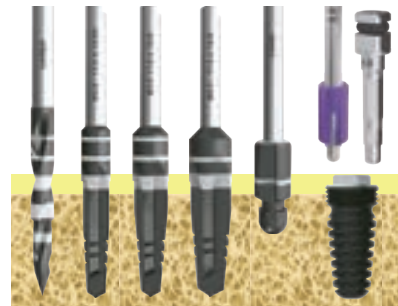

lança ▶ sist. duo ▶ ø4.6 ▶ ø5.5 ▶ countersink 5.5 obrigatório osso tipo I e II
ø2.0 ø3.8

INSTALAÇÃO DO IMPLANTE · IMPLANT INSTALLATION · INSTALACIÓN DEL IMPLANTE





1 BROCA LANÇA HELICOIDAL
HELICOIDAL POINTED START DRILL
FRESA LANZA HELICOIDAL

2 BROCA SISTEMA DUO 3.8MM
DUO SYSTEM DRILL 3.8MM
FRESA SISTEMA DUO 3.8MM

3 BROCA SISTEMA DUO 4.6MM
DUO SYSTEM DRILL 4.6MM
FRESA SISTEMA DUO 4.6MM

4 BROCA SISTEMA
DUO-DUOCON 4.6MM
DUO-DUOCON SYSTEM DRILL 4.6MM
FRESA SISTEMA DUO-DUOCON 4.6MM

IMPLANTE DUOCON 4.6MM
DUOCON IMPLANT 4.6MM
IMPLANTE DUOCON 4.6MM

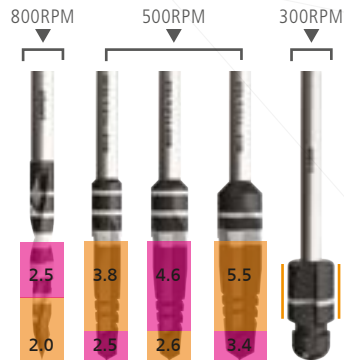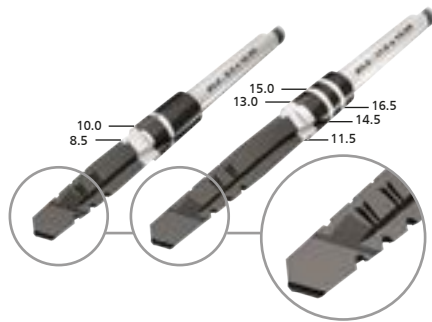

■ BROCA LANÇA HELICOIDAL
HELICOIDAL POINTED START DRILL
FRESA LANZA HELICOIDAL

● BROCA SISTEMA DUO
DUO SYSTEM DRILL
FRESA SISTEMA DUO

■ BROCA SISTEMA DUO-DUOCON
DUO-DUOCON SYSTEM DRILL
FRESA SISTEMA DUO-DUOCON

Ø 3.8 mm	2.0 ■	3.8 ●	*3.8 ■		
Ø 4.6 mm	2.0 ■	3.8 ●	4.6 ●	*4.6 ■	
Ø 5.5 mm	2.0 ■	3.8 ●	4.6 ●	5.5 ●	*5.5 ■

* Considerando a utilização de contra-ângulo redutor 16:1/20:1/ 27:1 e motor elétrico compatível.
 **As chaves de instalação do implante com conexão para contra-ângulo não devem ultrapassar o torque de 35N/cm.
 **As chaves de instalação do implante com conexão para torquímetro não devem ultrapassar o torque de 45N/cm.
 * Considering the use of 16: 1/20: 1/27: 1 contra-angle reducer and compatible with the drilling motor.
 ** The implant installation drivers with contra-angle connection should not exceed the torque of 35N/cm.
 ** The implant installation wrenches with torque wrench connection must not exceed 45N/cm.
 * Considerando la utilización del contra-ángulo reductor 16:1/20:1/ 27:1 y motor eléctrico compatible.
 **Las llaves de instalación del implante con conexión para contra-ángulo no debe superar el giro de 35N/cm.
 **Las llaves de instalación del implante con conexión para torque no debe superar el giro de 45N/cm.

DUOCON 3.8MM



lança ▶ sist. duo ▶ countersinh 3.8
ø2.0 ø3.8 obrigatório
osso tipo I e II

DUOCON 4.6MM




lança ▶ sist. duo ▶ ø4.6 ▶ countersinh 4.6
ø2.0 ø3.8 obrigatório
osso tipo I e II

DUOCON 5.5MM



lança ▶ sist. duo ▶ ø4.6 ▶ ø5.5 ▶ countersinh 5.5
ø2.0 ø3.8 obrigatório
osso tipo I e II

INSTALAÇÃO DO IMPLANTE · IMPLANT INSTALLATION · INSTALACIÓN DEL IMPLANTE

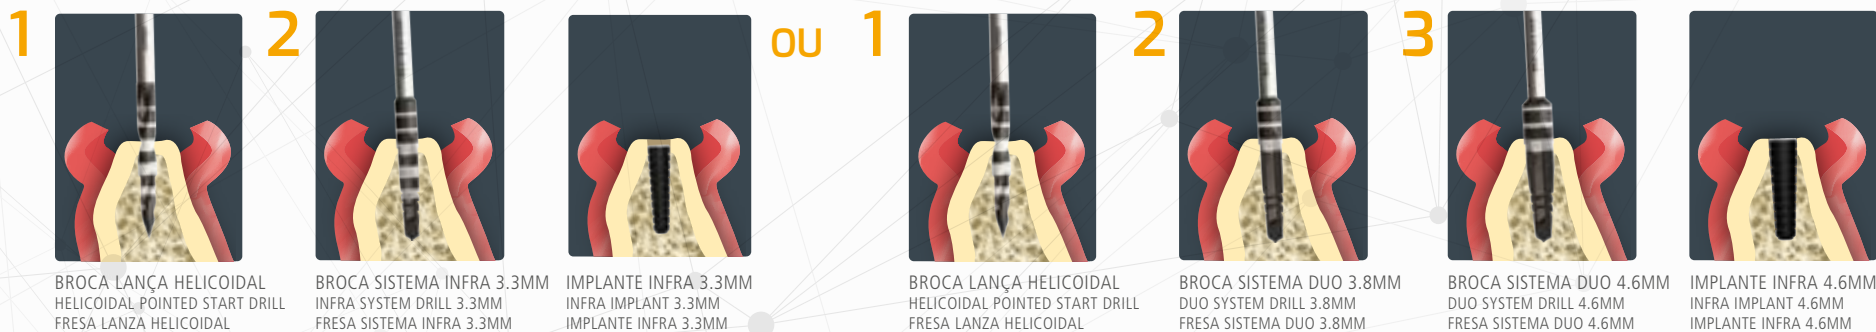

1 BROCA LANÇA HELICOIDAL
HELICOIDAL POINTED START DRILL
FRESA LANZA HELICOIDAL

2 BROCA SISTEMA INFRA 3.3MM
INFRA SYSTEM DRILL 3.3MM
FRESA SISTEMA INFRA 3.3MM

IMPLANTE INFRA 3.3MM
INFRA IMPLANT 3.3MM
IMPLANTE INFRA 3.3MM


ou 1

2 BROCA LANÇA HELICOIDAL
HELICOIDAL POINTED START DRILL
FRESA LANZA HELICOIDAL

3 BROCA SISTEMA DUO 3.8MM
DUO SYSTEM DRILL 3.8MM
FRESA SISTEMA DUO 3.8MM

BROCA SISTEMA DUO 4.6MM
DUO SYSTEM DRILL 4.6MM
FRESA SISTEMA DUO 4.6MM

IMPLANTE INFRA 4.6MM
INFRA IMPLANT 4.6MM
IMPLANTE INFRA 4.6MM



■ BROCA LANÇA HELICOIDAL
HELICOIDAL POINTED START DRILL
FRESA LANZA HELICOIDAL

● BROCA SISTEMA INFRA | DUO
INFRA | DUO SYSTEM DRILL
FRESA SISTEMA INFRA | DUO

Ø 3.3 mm	2.0 ■	3.3 ●	
Ø 3.8 mm	2.0 ■		3.8 ●
Ø 4.6 mm	2.0 ■		3.8 ● 4.6 ●


* Considerando a utilização de contra-ângulo redutor 16:1/20:1/ 27:1 e motor elétrico compatível.
 **As chaves de instalação do implante com conexão para contra-ângulo não devem ultrapassar o torque de 35N/cm.
 **As chaves de instalação do implante com conexão para torquímetro não devem ultrapassar o torque de 45N/cm.
 * Considering the use of 16: 1/20: 1/27: 1 contra-angle reducer and compatible with the drilling motor.
 ** The implant installation drivers with contra-angle connection should not exceed the of torque 35N/cm.
 ** The implant installation wrenches with torque wrench connection must not exceed 45N/cm.
 * Considerando la utilización del contra-ángulo reductor 16:1/20:1/ 27:1 y motor eléctrico compatible.
 **Las llaves de instalación del implante con conexión para contra-ángulo no debe superar el giro de 35N/cm.
 **Las llaves de instalación del implante con conexión para torque no debe superar el giro de 45N/cm.

INFRA 3.3MM



lança ø2.0 ▶ sist. infra ø3.3

INFRA 3.8MM

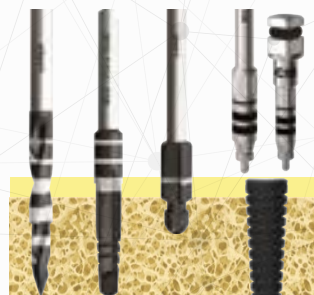

lança ø2.0 ▶ sist. duo ▶ countersink 3.8
ø3.8 obrigatório osso tipo I e II

INFRA 4.6MM



lança ø2.0 ▶ sist. duo ▶ ø4.6 ▶ countersink 4.6
ø3.8 obrigatório osso tipo I e II

CONE MORSE

Conexão cone morse indexado por um dodecágono interno.

Maior estabilidade protética e melhor distribuição de cargas ao implante.

Possibilita a moldagem direta do implante e modelo de trabalho com análogo de implante em posição precisa.

Conexión interna añade ventajas de la conexión con doce lados, interna y cono Morse.

Estabilidad protésica más grande y mejor distribución de cargas al implante.

Posibilita el moldado directo del implante y modelo de trabajo con análogo

Internal connection adds of the advantages of connection with internal twelve sides and Morse cone.

Greater prosthetic stability and better distribution of the implant loads


It enables the direct impression of the implant and working model with analog implant in precise position.



SISTEMA **INFRA**®

SISTEMA **Compact**®


SISTEMA **Duocon**®

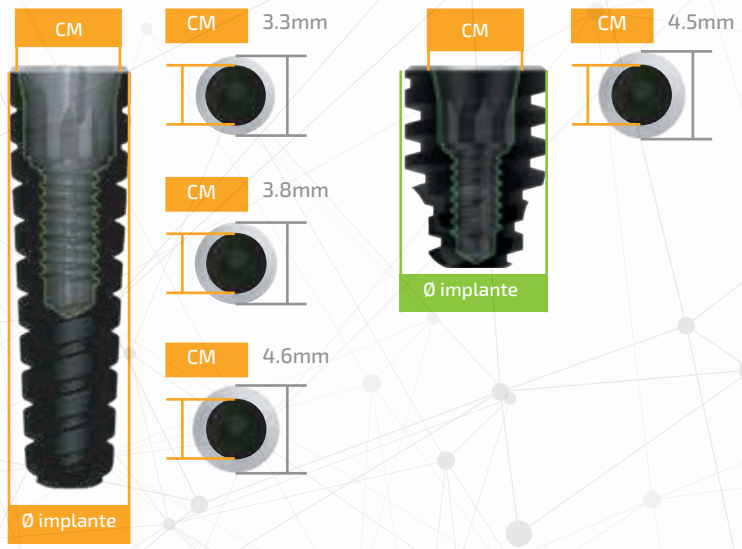


COMPATÍVEIS
 →
 Compatible
 Compatibles



NÃO COMPATÍVEIS
 ←
 Non Compatible
 No Compatibles

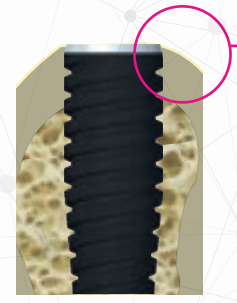

Plataforma Switch
 Switch Platform · Switch Plataforma

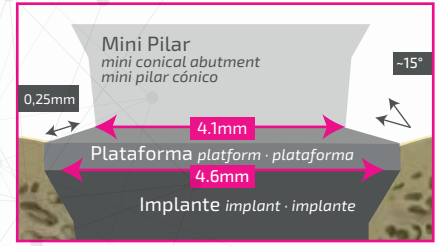

O desenho de plataforma cervical expandida, "switch platform", preserva o espaço biológico peri-implantar, diminui a reabsorção óssea vertical, diminuindo as recessões gengivais.

Expanded cervical platform design, "switch platform" it preserves the peri-implant biological space, it decreases the vertical bone resorption, reducing gingival recession.

Dibujo de plataforma cervical expandida, Switch plataforma, preserva el espacio biológico peri-implante, disminuye la reabsorción ósea vertical y las recesiones de la encía.

SEJA VOCÊ




- Implante com conexão Cone Morse e indexação dodecagonal interna;
- Superfície Vellox®;
- Plataforma "Switch";

- Implant with internal hexagon-indexed Morse Taper
- Vellox® Surface;
- Switch Platform;
- Indicated for all types of bones;
- Trapezoidal threads: Principle of clotting chamber;
- Recommended max torque: 45N.cm

- Indicado para todos os tipos de osso;
- Rosca trapezoidal: princípio de câmara de coágulo;
- Torque máximo recomendável: 45N.cm

- Implante con conexión Cono Morse e indexación dodecagonal interna;
- Superficie Vellox®;
- Plataforma Switch;
- Indicado a todos los tipos de hueso;
- Rosca trapezoidal: Principio de cámara de coágulo;
- Torque máximo recomendable: 45N.cm

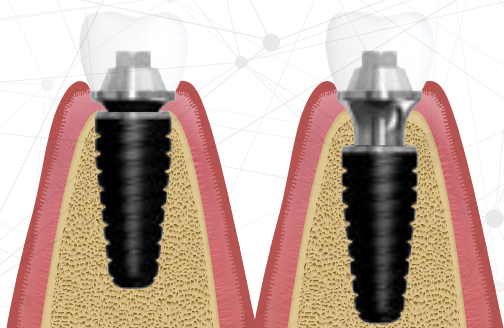

Dois protocolos de instalação: O implante ao nível da tábua óssea ou o implante abaixo da crista óssea.

Two installation protocols: Implant at bone level or implant below the bone crest.

Dos protocolos de instalación: El implante al nivel de la placa ósea o el implante por debajo de la cresta

TAPA IMPLANTE CM CM IMPLANT COVER SCREW · TAPA IMPLANTE CM



- Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.

CICATRIZADOR CM CM HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR CM



		H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 4.5	H = 5.0
CM	Ø3.3mm	01.231	01.232	01.233	01.234	01.235	01.236
	Ø4.5mm	01.237	01.238	01.239	01.240	01.241	01.242

Plataforma Platform · Plataforma	Ø corpo Ø body · Ø cuerpo	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm	16.5 mm	18.0 mm
CM	Ø 3.3mm	21.231	21.232	21.233	21.234	21.235		
CM	Ø 3.8mm	21.241	21.242	21.243	21.244	21.245		
CM	Ø 4.6mm	21.341	21.342	21.343	21.344	21.345		
CM	Ø 5.5mm							

- Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su tapa de implante.

■ NÍVEL ÓSSEO - Bone level | nivel óseo

- INFRA 3.3MM
- INFRA 3.8MM
- INFRA 4.6MM



■ NÍVEL INFRA ÓSSEO - Infra bone level | nivel infra óseo

- INFRA 3.3MM
- INFRA 3.8MM
- INFRA 4.6MM



SEJA VOCÊ



. Implante curto com conexão Cone Morse e indexação dodecagonal interna;

. Superfície Vellox®;

. Short Implant with Morse Taper connection and internal indexation;

. Vellox® Surface;

. Switch Platform;

. Indicated for all types of bones with height deficiency, as a viable alternative to grafts;

. Trapezoidal threads: Principle of clotting chamber, easier bone integration;

. Recommended max torque: 45N.cm

. Indicado para todos os tipos de osso com deficiência em altura sendo uma alternativa viável ao uso de enxertos;

. Rosca trapezoidal: princípio de câmara de coágulo, facilidade na osseointegração;

. Implante corto con conexión Cono Morse e indexación interna;

. Superfície Vellox®;

. Plataforma Switch;

. Indicado a todos los tipos de hueso con deficiencia en altura, como opción viable al uso de injertos;

. Rosca trapezoidal: Principio de cámara de coágulo, facilidad en la integración ósea;

. Torque máximo recomendable: 45N.cm

Plataforma Platform · Plataforma	Ø corpo Ø body · Ø cuerpo	6.0 mm	7.0 mm
CM	Ø 4.5mm	21.338	21.339

Filosofia Bone Level: Instalação do implante ao nível da tábua óssea, ou seja, a interface protética do implante deve se situar na mesma altura do osso cortical. Opcional para situações estéticas ou preferência profissional.

Bone Level Philosophy: Installation of the implant at the bone plate level, which means, the prosthetic implant interface should lie on the same height of the cortical bone. Optional for aesthetic situations or professional preference.

Filosofía Bone Level: Instalación del implante al nivel de la placa ósea, es decir, el interfaz protésico del implante debe situarse en la misma altura del hueso cortical. Opcional para situaciones estéticas o preferencia profesional.

Os implantes Compact são reabilitados com os componentes protéticos cone morse, plataforma CM, transmucoso 0 e 1.5mm

The Compact implants are rehabilitated with morse taper prosthetic components, CM platform, transmucoso 0 and 1.5mm.

Se rehabilitan a los implantes Compact con los componentes protésicos Cono Morse, plataforma CM, transmucoso 0 y 1.5mm.

COMPACT 4.5MM



TAPA IMPLANTE CM CM IMPLANT COVER SCREW · TAPA IMPLANTE CM



- Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.

CICATRIZADOR CM CM HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR CM



CM	H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 4.5	H = 5.0
Ø3.3mm	01.231	01.232	01.233	01.234	01.235	01.236
Ø4.5mm	01.237	01.238	01.239	01.240	01.241	01.242

SISTEMA *Duocon* 

SEJA
VOCÊ



- . Implante de corpo cônico com conexão Cone Morse e indexação dodecagonal interna;
- . Superfície Vellox®;
- . Plataforma "Switch";
- . Indicado para osso tipo III e IV;
- . Dupla rosca: Micro rosca cervical e roscas trapezoidais no corpo do implante, maior estabilidade primária e melhor osseointegração;
- . Torque máximo recomendável: 45N.cm

. Conical bodied implant with Morse Taper connection and internal dodecagonal indexing.

. Vellox® Surface;

. Switch Platform;

. Indicated for type III and IV bone;

. Double thread: Micro thread at the cervical region and trapezoidal threads in the body of the implant, greater primary stability and better osseointegration.

. Recommended max torque: 45N.cm

. Implante de cuerpo cónico con conexión Cono Morse e indexación dodecagonal interna;

. Superfície Vellox®;

. Plataform Switch;

. Indicado para hueso III y IV;

. Doble rosca: Microrrosca cervical y roscas trapezoidales en el cuerpo del implante, más estabilidad primaria y mejor integración ósea;

. Torque máximo recomendable: 45N.cm

Filosofia Bone Level (instalação do implante na mesma altura do osso cortical)

Bone Level Philosophy (installation of the implant at the cortical bone)

Filosofía Bone Level (instalación del implante debe situarse em la misma altura del hueso cortical)

TAPA IMPLANTE CM

CM IMPLANT COVER SCREW
TAPA IMPLANTE CM



- Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.

CICATRIZADOR CM

CM HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR CM



		H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 4.5	H = 5.0
CM	Ø3.3mm	01.231	01.232	01.233	01.234	01.235	01.236
	Ø4.5mm	01.237	01.238	01.239	01.240	01.241	01.242

Plataforma Platform · Plataforma	Ø corpo Ø body · Ø cuerpo	8.5	10.0	11.5	13.0	15.0
CM	Ø 3.8mm	21.221	21.222	21.223	21.224	21.225
DUOCON 4.6	Ø 4.6mm	21.331	21.332	21.333	21.334	21.335
DUOCON 4.6	Ø 5.5mm	21.421	21.422	21.423	21.424	21.425

- Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.

DUOCON 3.8MM DUOCON 4.6MM DUOCON 5.5MM



TAPA IMPLANTE DUOCON

DUOCON IMPLANT COVER SCREW
TAPA IMPLANTE DUOCON



- Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.

CICATRIZADOR DUOCON


DUOCON HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR DUOCON



		H = 1	H = 2	H = 4	H = 6
DUOCON 3.8	Ø4.5mm	01.211	01.212	01.213	01.214
	Ø4.5mm	01.421	01.422	01.423	01.424

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE IMPLANTE

DIRECT SEQUENCE OVER IMPLANT · SECUENCIA DIRECTA SOBRE IMPLANTE

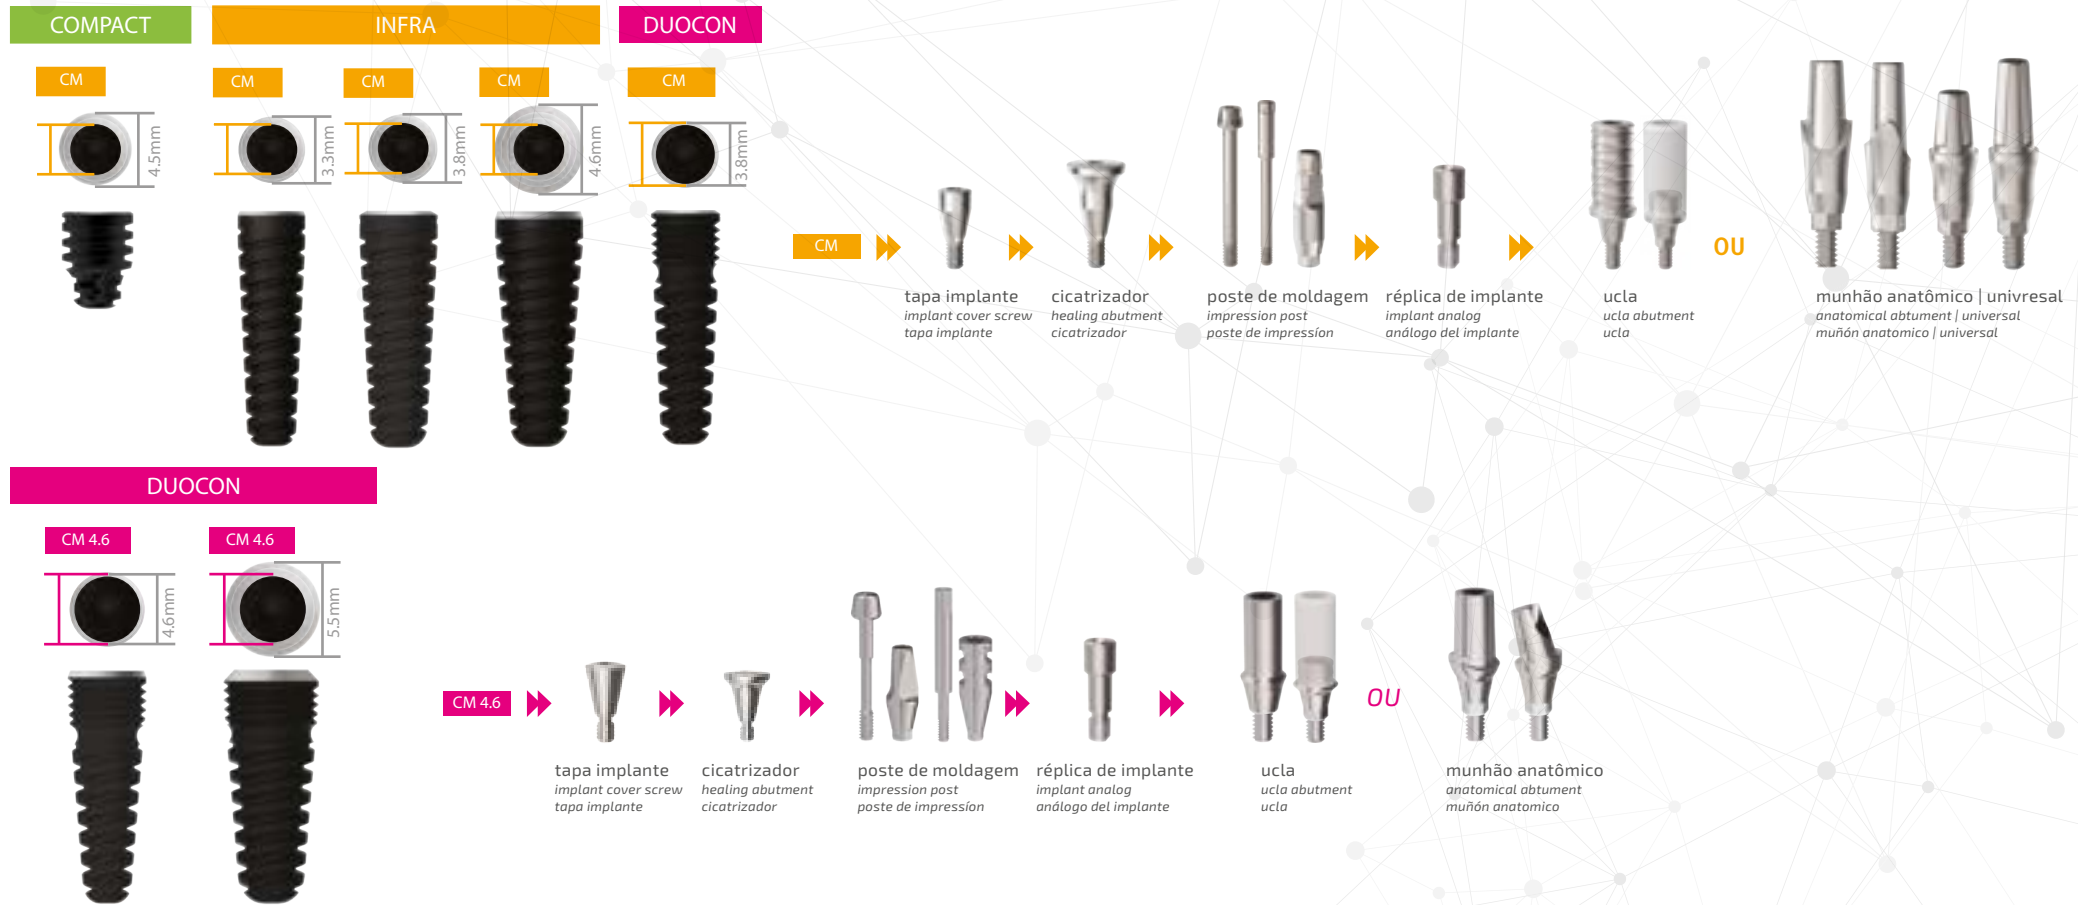


CICATRIZADOR HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR

. Componente em titânio;
. Utilizado para modelar o sulco gengival.

. Titanium components;
. Used to shape gingival sulcus.

. Componente en titanio;
. Utilizado para modelar el surco gingival.



CICATRIZADOR CM CM HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR CM

CM	H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 4.5	H = 5.0
Ø3.3mm	01.231	01.232	01.233	01.234	01.235	01.236
Ø4.5mm	01.237	01.238	01.239	01.240	01.241	01.242

CICATRIZADOR DUOCON DUOCON HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR DUOCON



		H = 1	H = 2	H = 4	H = 6
DUOCON 3.8	Ø4.5mm	01.211	01.212	01.213	01.214
DUOCON 4.6	Ø4.5mm	01.421	01.422	01.423	01.424

POSTE DE MOLDAGEM IMPRESSION POST · POSTE DE IMPRESIÓN

. Componente em aço inoxidável;
. Transfere posição e molde para elaboração da prótese.

. Stainless steel component;
. Transfers position and casting for the making of the prosthesis.

. Componente en acero inoxidable;
. Transfiere la posición del implante o pilar intermediario al modelo de trabajo para elaboración de la prótesis.



MOLDEIRA FECHADA DUOCON

DUOCON CLOSED TRAY IMPRESSION TECHNIQUE
CUBETA CERRADA DUOCON

	Curto Short Corto	Longo Larg Ancho
DUOCON 3.8	08.113	08.114
DUOCON 4.6	08.311	08.312



MOLDEIRA ABERTA DUOCON

DUOCON OPEN TRAY IMPRESSION TECHNIQUE
CUBETA ABIERTA DUOCON

	Curto Short Corto	Longo Larg Ancho
DUOCON 3.8	08.125	08.126
DUOCON 4.6	08.313	08.314

RÉPLICA DE IMPLANTE IMPLANT ANALOG · ANÁLOGO DEL IMPLANTE

. Componente em aço inoxidável;
. Auxilia a confecção da prótese ou planejamento protético.

. Stainless steel component;

. Assists the making of the prosthesis or prosthetic planning.

. Componente en acero inoxidable;

. Auxilia la confección de la prótesis o planificación protésica.



RÉPLICA DE IMPLANTE CM

CM IMPLANT ANALOG
ANÁLOGO DEL IMPLANTE CM

CM	09.104
----	--------



RÉPLICA DE IMPLANTE DUOCON

DUOCON IMPLANT ANALOG
ANÁLOGO DEL IMPLANTE DUOCON

CM 4.6	09.304
--------	--------

UCLA UCLA ABUTMENT · UCLA

· Componente em titânio;
· Utilizada preferencialmente para provisórios.

· Titanium component;
· Used for provisional prosthesis.

· Componente en titânio;
· Utilizada preferencialmente para provisionales.

· Componente calcinável com base metálica CoCr;
· Metal cerâmico, melhor adaptação.

· Castable component with CoCr metallic base;
· Ceramic metal, best fit to implant.

· Componente calcinable con base metálica CoCr;
· Metal cerâmico, mejor adaptación.

TITÂNIO CM CM TITANIUM · TITANIO CM

		H = 0	H = 1.5
CM		10.121	10.125
		10.122	10.126

TITÂNIO DUOCON DUOCON TITANIUM · TITANIO DUOCON

		H = 0	
DUOCON 3.8		10.121	10.122
DUOCON 4.6		10.331	10.332

BASE METÁLICA CM CM METALLIC BASE · BASE METALICA CM

		H = 0	H = 1.5
CM		10.123	10.127
		10.124	10.128

BASE METÁLICA DUOCON DUOCON METALLIC BASE · BASE METALICA DUOCON

		H = 0	
DUOCON 3.8		10.123	10.124
DUOCON 4.6		10.333	10.334

PARAFUSO PROTÉTICO CM CM PROSTHETIC SCREW · TORNILLO PROTÉSICO CM



CM	05.310	05.306
	H = 1,5	H = 0


PARAFUSO PROTÉTICO DUOCON DUOCON PROSTHETIC SCREW · TORNILLO PROTÉSICO DUOCON



DUOCON 3.8	05.306	DUOCON 4.6	05.305
------------	--------	------------	--------

Torque recomendável: 15N.cm
Recommended torque | Torque recomendable: 15N.cm

ANATOMICAL ABUTMENT PILAR · MUÑÓN ANATÓMICO

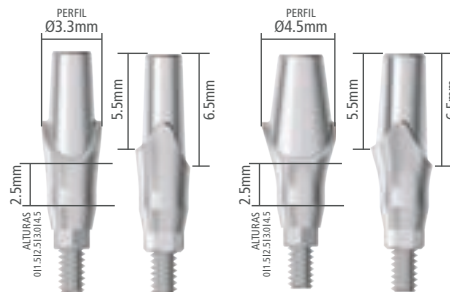


· Componente em titânio;
· Prótese cimentada;
· Hexagonal.

· Titanium component;
· Cemented prosthesis;
· Hexagonal.

· Componente en titânio;
· Prótesis cementada;
· Hexagonal.

MUNHÃO CM CM ABUTMENT PILAR · MUÑÓN CM


		H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 4.5
CM	Ø3.3mm	03.421	03.422	03.423	03.424	03.425
	Ø4.5mm	03.426	03.427	03.428	03.429	03.430



MUNHÃO DUOCON DUOCON ABUTMENT PILAR · MUÑÓN DUOCON

		H = 1.5	H = 3.0
DUOCON 3.8	Ø4.5mm	03.111	03.112
DUOCON 4.6	Ø5.5mm	03.117	03.118

ANGULADO CM CM ANGLED · ANGULADO CM

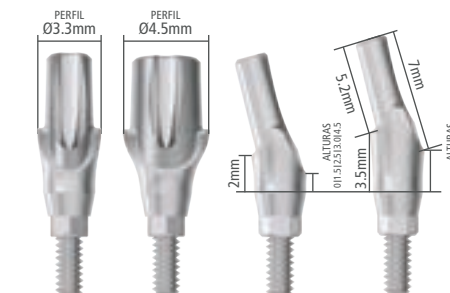

		H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0
CM	17°	Ø3.3mm	03.431	03.432	03.433
		Ø4.5mm	03.439	03.440	03.441
	30°	Ø3.3mm	03.435	03.436	03.437
		Ø4.5mm	03.443	03.444	03.445

ANGULADO DUOCON DUOCON ANGLED · ANGULADO DUOCON




		H = 1.0	H = 2.0
DUOCON 3.8	17°	03.122	03.124
	30°	03.126	03.128
DUOCON 4.6	17°	03.222	03.224
	30°	03.226	03.228

MUNHÃO UNIVERSAL CM CM UNIVERSAL ABUTMENT PILAR · MUÑÓN UNIVERSAL CM

- . Componente em titânio;
- . Prótese cimentada e parafusada;
- . Hexagonal.

- . Titanium component;
- . Cemented and screwed prosthesis;
- . Hexagonal.

- . Componente en titânio;
- . Prótesis cementada y atornillada;
- . Hexagonal.

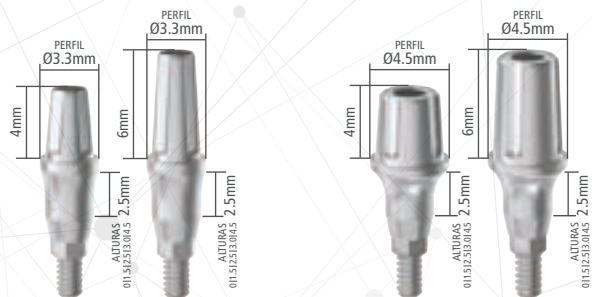

		H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 2.5
CM	4mm	Ø3.3mm 03.401	03.402	03.403	03.404	03.405
		Ø4.5mm 03.411	03.412	03.413	03.414	03.415
6mm		Ø3.3mm 03.406	03.407	03.408	03.409	03.410
		Ø4.5mm 03.416	03.417	03.418	03.419	03.420




TRANSFER IMPRESSION POST · POSTE DE IMPRESIÓN



COPING PROVISÓRIO TEMPORARY ABUTMENT COPING · COPING PROVISIONAL



COPING CALCINÁVEL CASTABLE ABUTMENT COPING · COPING CASTABLE

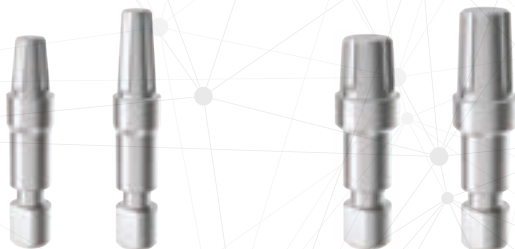

CONJUNTO PARA MUNHÃO UNIVERSAL CM (TRANSFER E COPING)

CM UNIVERSAL ABUTMENT PILAR SET (IMPRESSION POST AND COPING)

CONJUNTO PARA MUÑÓN UNIVERSAL CM (POSTE DE IMPRESIÓN Y COPING)

CM	4mm	Ø3.3mm 03.308
		Ø4.5mm 03.310
6mm		Ø3.3mm 03.309
		Ø4.5mm 03.311

RÉPLICA MUNHÃO UNIVERSAL CM


CM UNIVERSAL ABUTMENT PILAR ANALOGUE

ANÁLOGO MUÑÓN UNIVERSAL CM

CM	4mm	Ø3.3mm 09.105
		Ø4.5mm 09.107
6mm		Ø3.3mm 09.106
		Ø4.5mm 09.108

SEQUÊNCIA DE INTERMEDIÁRIO SOB O IMPLANTE

PROSTHETIC INTERMEDIATE SEQUENCE · SECUENCIA DE INTERMEDIARIO BAJO EL IMPLANTE

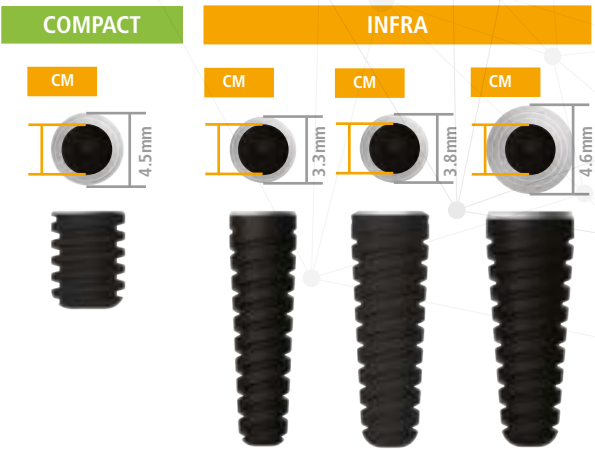

Cada intermediário possui sua respectiva sequência protética.
 Each intermediary has its respective prosthetic sequence.
 Cada intermediario posee su respectiva secuencia protésica.




MINI PILAR CÔNICO MINI CONICAL ABUTMENT · MINI PILAR CÓNICO

- Componente em titânio;
- Prótese múltipla e parafusada;
- Espaço mínimo inter-oclusal de 4.5mm.

- Titanium component;
- Multiple and screw retained prosthesis;
- Minimum interocclusal space of 4.5mm.

- Componente en titanio;
- Prótesis múltipla y atornillada;
- Espacio mínimo interoclusal de 4.5mm.



MINI PILAR CÔNICO CM CM MINI CONICAL ABUTMENT · MINI PILAR CÓNICO CM

	H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 4.5
CM	Ø4.8mm	Ø4.8mm	Ø4.8mm	Ø4.8mm	Ø4.8mm
	02.411	02.412	02.413	02.414	02.415


Torque recomendável: 15N.cm Recommended torque | Torque recomendable: 15N.cm



MINI PILAR CÔNICO DUOCON DUOCON MINI CONICAL ABUTMENT · MINI PILAR CÓNICO DUOCON

	H = 1	H = 2	H = 4	H = 6
CM 3.8	02.221	02.222	02.223	02.224
CM 4.6	02.141	02.142	02.143	02.144

Torque recomendável: 15N.cm Recommended torque | Torque recomendable: 15N.cm



ANGULADO CM CM ANGLED · ANGULADO CM

	H = 0		H = 1.5		H = 2.5		H = 3.0	
	17°	30°	17°	30°	17°	30°	17°	30°
CM	02.420	02.424	02.421	02.425	02.422	02.426	02.423	02.427

ANGULADO DUOCON DUOCON ANGLED · ANGULADO DUOCON

	H = 1		H = 2		H = 3	
	17°	30°	17°	30°	17°	30°
CM 3.8	02.311	02.316	02.312	02.317	02.313	02.318
CM 4.6	02.321	02.326	02.322	02.327	02.323	



TRANSFER MINI PILAR CÔNICO MINI CONICAL ABUTMENT IMPRESSION POST POSTE DE IMPRESIÓN MINI PILAR CÓNICO

Moldeira Fechada Closed Tray Impression Technique Impresión Cubeta Cerrada
Moldeira Aberta Open Tray Impression Technique Impresión Cubeta Abierta

02.109

02.110

RÉPLICA MINI PILAR CÔNICO MINI CONICAL ABUTMENT ANALOGUE ANÁLOGO MINI PILAR CÓNICO

02.108

CICATRIZADOR ESTREITO MINI PILAR CÔNICO NARROW MINI CONICAL ABUTMENT HEALING CAP CICATRIZADOR ESTRECHO MINI PILAR CÓNICO

02.103

COPING MINI PILAR CÔNICO MINI CONICAL ABUTMENT COPING · COPING MINI PILAR CÓNICO

Torque recomendável: 10N.cm Recommended torque | Torque recomendable: 10N.cm

Base Metálica CoCr
CoCr Metallic Base
Base Metálica CoCr

02.128

Titânio
Titanium | Titano

02.101

Calcinável
Castable | Calcinable

02.102

Calcinável POM
POM Castable | Calcinable POM

02.112

Curto Cobalto Cromo
CoCr Short
Corta Cromo Cobalto

02.129

MICRO PILAR CÔNICO CM

CM MICRO CONICAL ABUTMENT · MICRO PILAR CÓNICO CM

- Componente em titânio;
- Prótese múltipla e parafusada;
- Espaço mínimo inter-oclusal de 4.5mm.

- Titanium component;
- Multiple and screw retained prosthesis;
- Minimum interocclusal space of 4.5mm.

- Componente en titânio;
- Prótesis múltipla y atornillada;
- Espacio mínimo interoclusal de 4.5mm.



	H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 4.5
CM	Ø3.3mm	Ø3.3mm	Ø3.3mm	Ø3.3mm	Ø3.3mm
	02.401	02.402	02.403	02.404	02.405

Torque recomendável: 15N.cm

Recommended torque | Torque recomendable: 15N.cm

TRANSFER MICRO PILAR CÔNICO

MICRO CONICAL ABUTMENT IMPRESSION POST
POSTE DE IMPRESIÓN MICRO PILAR CÓNICO

Moldeira Aberta

Open Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Abierta



02.416

RÉPLICA MICRO PILAR CÔNICO

MICRO CONICAL ABUTMENT ANALOGUE
ANÁLOGO MICRO PILAR CÓNICO



02.410

CICATRIZADOR MICRO PILAR CÔNICO

MICRO CONICAL ABUTMENT HEALING CAP
CICATRIZADOR MICRO PILAR CÓNICO



02.406

COPING MICRO PILAR CÔNICO

MICRO CONICAL ABUTMENT COPING · COPING MICRO PILAR CÓNICO

Torque recomendável: 10N.cm Recommended torque | Torque recomendable: 10N.cm

Base Metálica CoCr

CoCr Metallic Base | Base Metálica CoCr

02.409

Titânio

Titanium | Titânio

02.407

Calcinável

Castable | Calcinable

02.408

PILAR CÔNICO DUOCON

DUOCON CONICAL ABUTMENT · PILAR CÓNICO DUOCON

- Componente em titânio;
- Prótese múltipla ou unitária;
- Espaço mínimo oclusal de 6.7mm.

- Titanium component;
- Multiple or unit prosthesis;
- Minimum occlusal space of 6.7mm.

- Componente en titânio;
- Prótesis múltipla o unitaria;
- Espacio mínimo oclusal de 6.7mm.



ANGULADO

ANGLED · ANGULADO

H = 2 | 17°

DUOCON 3.8	06.136	06.137
DUOCON 4.6	06.138	06.139

TRANSFER PILAR CÔNICO

CONICAL ABUTMENT IMPRESSION POST
POSTE DE IMPRESIÓN PILAR CÓNICO

Moldeira Fechada
Closed Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Cerrada

Moldeira Aberta
Open Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Abierta



06.112

06.113

06.114

RÉPLICA PILAR CÔNICO

CONICAL ABUTMENT ANALOGUE
ANÁLOGO PILAR CÓNICO



06.110

06.111

CICATRIZADOR PILAR CÔNICO

CONICAL ABUTMENT HEALING CAP
CICATRIZADOR MICRO PILAR CÓNICO



06.101

COPING PILAR CÔNICO

CONICAL ABUTMENT COPING · COPING PILAR CÓNICO

Torque recomendável: 10N.cm Recommended torque | Torque recomendable: 10N.cm

Base Metálica CoCr

CoCr Metallic Base | Base Metálica CoCr

06.127

06.128

Titânio

Titanium | Titânio

06.103

06.105

Calcinável


Castable | Calcinable

06.102

06.104

OVERDENTURE O'RING O'RING ABUTMENT · OVERDENTURE O'RING

- Componente em titânio; Titanium component;
- Parafusado direto ao implante; Screwed directly into the implant;
- Prótese overdenture; Overdenture prosthesis;
- Sistema Attachment Bola. Attachment System.
- Componente en titanio; Titanium component;
- Tornillo directo al implante; Screwed directly into the implant;
- Prótesis overdenture; Overdenture prosthesis;
- Sistema de retención. Attachment System.

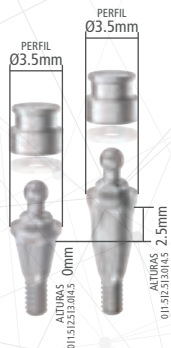

OVERDENTURE O'RING CM

CM O'RING ABUTMENT · OVERDENTURE O'RING CM

	H = 0	H = 1.5	H = 2.5	H = 3.0	H = 4.5
CM	Ø3.5mm	Ø3.5mm	Ø3.5mm	Ø3.5mm	Ø3.5mm
	04.141	04.142	04.143	04.144	04.145

OVERDENTURE O'RING DUOCON

DUOCON O'RING ABUTMENT · OVERDENTURE O'RING DUOCON

	H = 0.5	H = 1.0	H = 2.0	H = 4.0	H = 6.0
CM 3.8		04.122	04.123	04.124	04.125
CM 4.6	04.211	04.212	04.213	04.214	04.215



RÉPLICA OVERDENTURE O'RING
O'RING ABUTMENT ANALOGUE
ANÁLOGO OVERDENTURE O'RING

04.311



CÁPSULA DE O'RING COM ANEL POSICIONADO
O'RING METAL CAPSULE WITH RUBBER RING
CÁPSULA DE O'RING CON ANILLO POSICIONADO

04.306



CÁPSULA PLÁSTICA DE O'RING
O'RING PLASTIC CAPSULE (IMPRESSION)
CÁPSULA PLÁSTICA DE O'RING

04.309




ANEL PLÁSTICO ESPAÇADOR DE O'RING
O'RING SPACER PLASTIC RING
ANILLO PLÁSTICO ESPACIADOR DE O'RING

04.308

ANEL DE REPOSIÇÃO PARA CÁPSULA DE O'RING (BORRACHA)
RUBBER RING FOR O'RING CAPSULE REPLACEMENT
ANILLO DE REPOSICIÓN PARA CÁPSULA DE O'RING (GOMA)

04.307

ACESSÓRIOS PROTÉTICOS PROSTHETIC ACCESSORIES · ACCESORIOS PROTÉSICOS

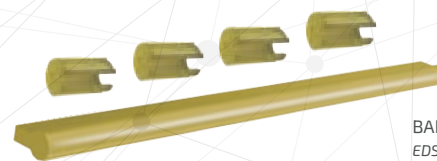


BARRA CLIP (AMARELA)
EDS BAR (YELLOW) | BARRA (AMARILLA)

26.001

CLIP FINAL (NYLON AMARELA)
FINAL CLIP (YELLOW NYLON) | CLIP FINAL (NYLON AMARILLO)
CONJUNTO COM 04 UNIDADES

26.002

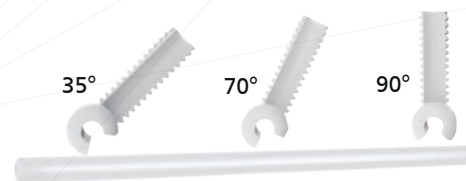

BARRA CLIP FINAL (BRANCO)
FINAL BAR CLIP (WHITE) | BARRA CLIP FINAL (BLANCA)

26.008

CLIP FINAL (BRANCO) FINAL CLIP (WHITE) | CLIP FINAL (BLANCO)

35°	26.009	70°	26.010	90°	26.011
-----	--------	-----	--------	-----	--------



DISPOSITIVO PROLONGADOR DE CILINDRO PROVISÓRIO
EXTENSION DEVICE WITH PROVISIONAL CYLINDER
DISPOSITIVO DE PROLONGACIÓN DE CILINDRO PROVISORIO

5mm 20.101

15mm 20.102



DISPOSITIVO PROLONGADOR BILATERAL
DE UCLA / COPING
BILATERAL EXTENSION DEVICE (UCLA / COPING)
DISPOSITIVO DE PROLONGACIÓN BILATERAL
(UCLA / COPING)

10mm 20.103

Implantes · Implants · Implantes

HEXAGONO EXTERNO

Conexão Hexágono Externo
external hexagon connection
conexión hexágono externo

Liberdade Rotacional + Resistência Mecânica

Rotational Freedom + Strength . Libertad de Rotación + Resistencia Mecánica

A conexão entre o implante e os componentes protéticos são realizados por um hexágono externo.

Liberdade rotacional e maior resistência mecânica à inserção.

The connection between the implant and prosthetic components is performed by an external hexagon.

Rotational freedom and greater mechanical resistance to insertion.

Un hexágono externo ejecuta la conexión entre el implante y los componentes protéticos. Libertad de rotación y resistencia mecánica más grande a la inserción.







Plataforma Convencional



Ø implante

Plataforma Convencional *Standart Platform · Plataforma Convencional*

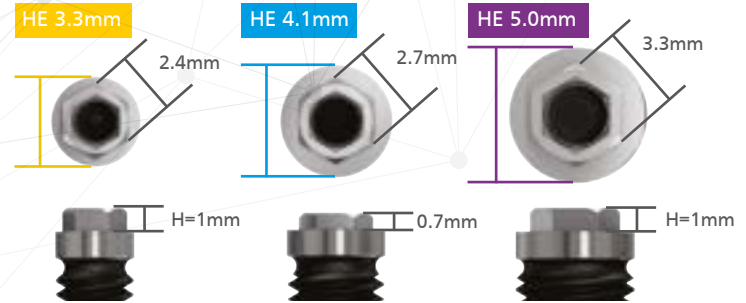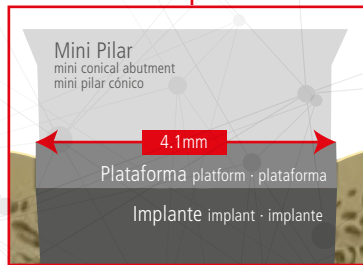

Plataforma SWITCH





Ø implante

Plataforma Switch *Switch Platform · Plataforma Switch*

Desenho de plataforma cervical expandida, "platform switch", preserva o espaço biológico peri-implantar, diminui a reabsorção óssea vertical, diminuindo as recessões gengivais.

Expanded cervical platform design, "switch platform" it preserves the peri-implant biological space, and decreases the vertical bone resorption, reducing gingival recession.

Dibujo de plataforma cervical expandida, plataforma Switch, preserva el espacio biológico peri-implante, disminuye la reabsorción ósea vertical y las recesiones de la encía.

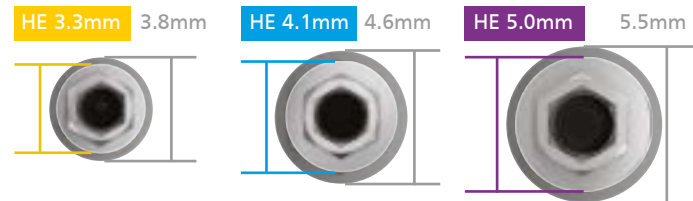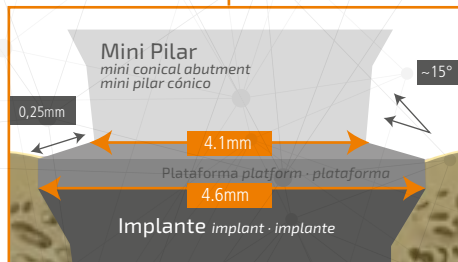




SEJA VOCÊ



5037

signovinces.com.br

- . Implante cônico;
- . Hexágono externo para conexão dos componentes;
- . Superfície Vellox®;
- . Plataforma "Switch";
- . Indicado para todos os tipos de osso;
- . Rosca trapezoidal: princípio da câmara de coágulo;
- . Torque máximo recomendável: 45N.cm

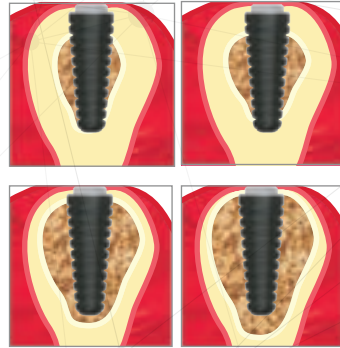

- . Conical implant;
- . External hex for component connection;
- . Internal torque;
- . Vellox® Surface;
- . Switch Platform;
- . Indicated for all bone types;
- . Trapezoidal threads: Principle of clotting chamber;
- . Recommended max torque: 45N.cm

- . Implante cônico;
- . Hexágono externo para conexión de los componentes;
- . Torque interno;
- . Superfície Vellox®;
- . Plataforma Switch;
- . Indicado a todos los tipos de hueso;
- . Rosca trapezoidal: Principio de cámara de coágulo;
- . Torque máximo recomendable: 45N.cm

TAPA IMPLANTE IMPLANT COVER SCREW · TAPA IMPLANTE



- . Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- . Implants are sold with their implant cover.
- . Los implantes se venden con su funda de implante.

CICATRIZADOR HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR




DIVERGENTE AESTHETIC CONTOUR · DIVERGENTE

	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5	H = 6	H = 7
			Ø5.0mm		Ø5.0mm	Ø5.0mm
HE 3.3	01.201	01.202	01.203	01.204	01.205	
HE 4.1	01.401	01.402	01.411	01.404	01.414	01.417

Plataforma <small>Platform · Plataforma</small>	Ø corpo <small>Ø body · Ø cuerpo</small>	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm	16.5 mm	18.0 mm
HE 3.3	Ø 3.8mm	21.206	21.207	21.208	21.209	21.210		
HE 4.1	Ø 4.6mm	21.306	21.307	21.308	21.309	21.310		
HE 5.0								

- . Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- . Implants are sold with their implant cover.
- . Los implantes se venden con su funda de implante.

■ ARES 3.8MM

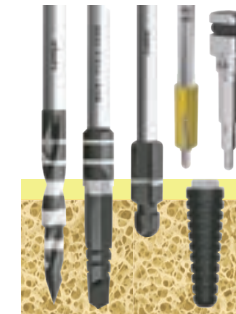

■ ARES 4.6MM



RETO STRAIGHT · RECTO

	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5	H = 6
HE 3.3	01.206	01.207	01.208	01.209	
HE 4.1	01.406	01.409	01.407	01.410	01.408



HE FIT HE FIT · HE FIT


	H = 2	H = 3	H = 4
HE 3.3	01.220	01.221	01.222
HE 4.1	01.418	01.419	01.420

SISTEMA **Duo**®

SEJA
VOCÊ



- . Implante cônico;
- . Hexágono externo para conexão dos componentes;
- . Superfície Vellox®;
- . Plataforma "Switch";
- . Indicado para osso tipo III e IV;
- . Dupla rosca;
- . Torque máximo recomendável: 45N.cm

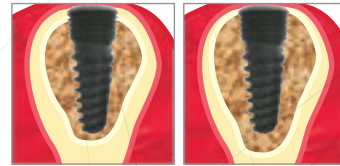

- . Conical implant;
- . External hex for component connection;
- . Internal torque;
- . Vellox® Surface;
- . Switch Platform;
- . Indicated for bone type III and IV;
- . Double threads;
- . Recommended max torque: 45N.cm

- . Implante cónico;
- . Hexágono externo para conexión de los componentes;
- . Torque interno;
- . Superfície Vellox®;
- . Plataforma Switch;
- . Indicado para hueso III y IV;
- . Rosca doble;
- . Torque máximo recomendable: 45N.cm

Plataforma <i>Platform . Plataforma</i>	Ø corpo <i>Ø body . Ø cuerpo</i>	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm
HE 3.3	Ø 3.8mm	21.201	21.202	21.203	21.204	21.205
HE 4.1	Ø 4.6mm	21.301	21.302	21.303	21.304	21.305
HE 5.0	Ø 5.5mm	21.401	21.402	21.403	21.404	21.405

- Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.

TAPA IMPLANTE IMPLANT COVER SCREW · TAPA IMPLANTE



- Os implantes são vendidos com o seu tapa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.


CICATRIZADOR HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR




DIVERGENTE AESTHETIC CONTOUR · DIVERGENTE

	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5	H = 6	H = 7
HE 3.3	01.201	01.202	01.203	01.204	01.205	
HE 4.1	01.401	01.402	01.411	01.404	01.414	01.417
HE 5.0	01.501	01.502	01.503	01.504	01.505	


DUO 3.8MM

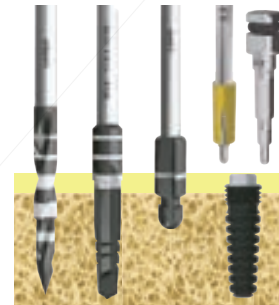

DUO 4.6MM

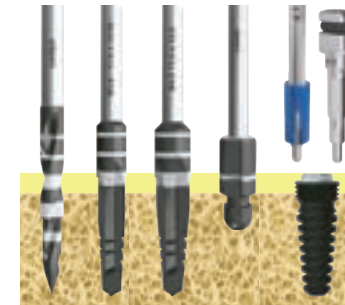

DUO 5.5MM

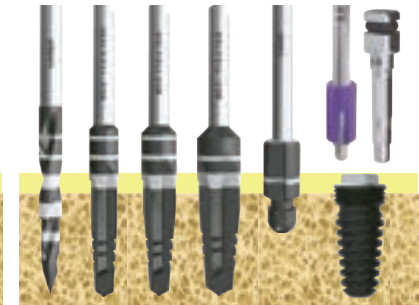

RETO STRAIGHT · RECTO

	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5	H = 6
HE 3.3	01.206	01.207	01.208	01.209	
HE 4.1	01.406	01.409	01.407	01.410	01.408
HE 5.0	01.506	01.507	01.508	01.509	




HE FIT HE FIT · HE FIT

	H = 2	H = 3	H = 4
HE 3.3	01.220	01.221	01.222
HE 4.1	01.418	01.419	01.420
HE 5.0	01.514	01.515	01.516

SEJA VOCÊ



- . Implante cilíndrico;
- . Hexágono externo para conexão dos componentes;
- . Torque interno;
- . Superfície Vellox®;
- . Indicado para osso tipo I e II;
- . Torque máximo recomendável: 45N.cm

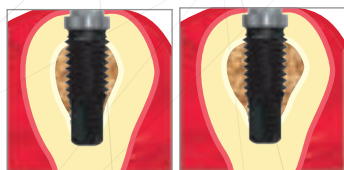

- . Cylindrical implant;
- . External hex for component connection;
- . Internal torque;
- . Vellox® Surface;
- . Indicated for bone type I and II;
- . Double threads;
- . High compacting power;
- . Recommended max torque: 45N.cm

- . Implante cilíndrico;
- . Hexágono externo para conexión de los componentes;
- . Torque interno;
- . Superfície Vellox®;
- . Indicado para hueso I y II;
- . Rosca doble;
- . Alto poder de compactación;
- . Torque máximo recomendable: 45N.cm

Plataforma Platform · Plataforma	Ø corpo Ø body · Ø cuerpo	8.5 mm	10.0 mm	11.5 mm	13.0 mm	15.0 mm
HE 3.3	Ø 3.25mm	21.211	21.212	21.213	21.214	21.215
HE 4.1	Ø 3.75mm	21.311	21.312	21.313	21.314	21.315
	Ø 4.00mm	21.321	21.322	21.323	21.324	21.325
HE 5.0	Ø 5.00mm	21.411	21.412	21.413	21.414	21.415

- Os implantes são vendidos com o seu tampa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.

TAPA IMPLANTE IMPLANT COVER SCREW · TAPA IMPLANTE



- Os implantes são vendidos com o seu tampa implante.
- Implants are sold with their implant cover.
- Los implantes se venden con su funda de implante.

CICATRIZADOR HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR



DIVERGENTE AESTHETIC CONTOUR · DIVERGENTE

	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5	H = 6	H = 7
HE 3.3	01.201	01.202	01.203	01.204	01.205	
HE 4.1	01.401	01.402	01.411	01.404	01.414	01.417
HE 5.0	01.501	01.502	01.503	01.504	01.505	




RETO STRAIGHT · RECTO

	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5	H = 6
HE 3.3	01.206	01.207	01.208	01.209	
HE 4.1	01.406	01.409	01.407	01.410	01.408
HE 5.0	01.506	01.507	01.508	01.509	



HE FIT HE FIT · HE FIT

	H = 2	H = 3	H = 4
HE 3.3	01.220	01.221	01.222
HE 4.1	01.418	01.419	01.420
HE 5.0	01.514	01.515	01.516

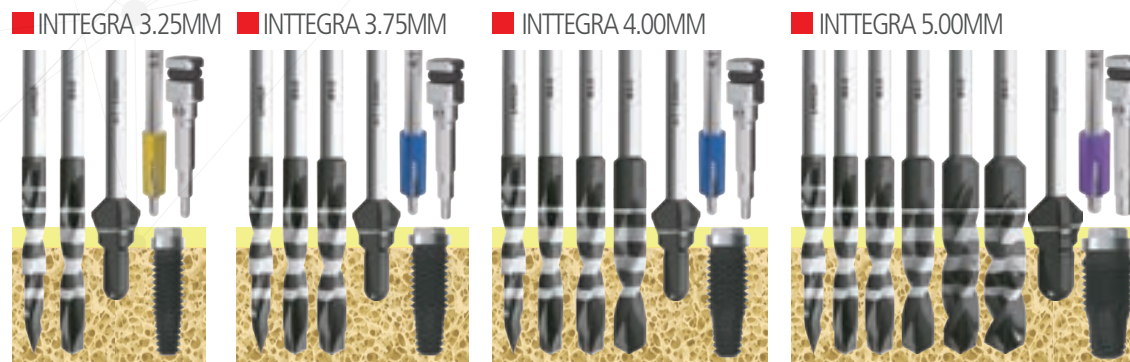

COMPONENTES HE FIT

HE FIT COMPONENTS · COMPONENTES HE FIT

- Primeiro sistema de implantes totalmente desenvolvido sob o conceito de plataforma "switch";
- Componentes protéticos para implantes de hexágono externo, com perfil de emergência gengival paralelo para minimizar a reabsorção óssea ao redor dos implantes;
- Ajuda a manter a saúde dos tecidos peri-implantares, pois aumenta o volume de tecido mole e fibras circulares de proteção, diminuindo a circunferência na área crítica de conexão implante-pilar.

· First dental implant system designed under the switching platform concept;


· External hex prosthetic abutments, with a parallel emergency profile that decreases the bone resorption around the implants;

· Helps to maintain the health of peri-implant tissues, increases the soft tissue volume and the protection round fibers, decreasing the perimeter in the critical area of implant - abutment interface.

· Primero sistema de implantes e pilares protéticos totalmente desarrollado bajo el concepto de cambio de plataforma "switch platform";

· Pilares Protéticos para implantes hexágono externo, con perfil de emergencia gingival paralelo para disminuir la reabsorción ósea alrededor de los implantes.

· Ayuda a mantener la salud de los tejidos peri-implantares, aumenta el volumen de tejidos blandos y de las fibras circulares de protección, disminuyendo la circunferencia en la zona crítica de conexión implante pilar.

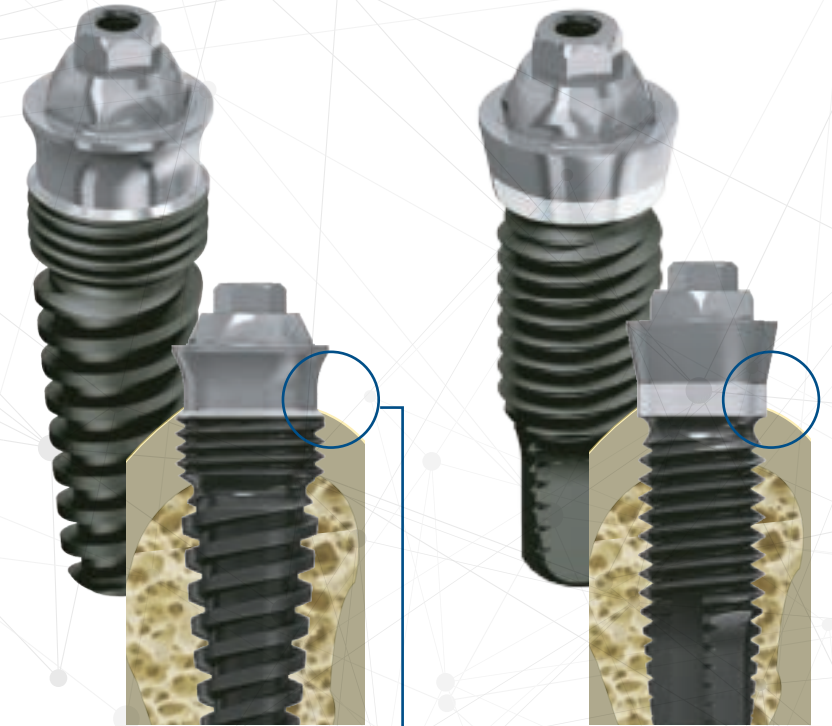

CICATRIZADOR HE FIT
HEALING ABUTMENT HE FIT · CICATRIZADOR HE FIT



MUNHÃO ESPECIAL COM PREPARO HE FIT
HE FIT CEMENT-ON-CROWN ABUTMENT
MUÑÓN ESPECIAL CON PREPARO HE FIT




POSTE DE MOLDAGEM HE FIT
HE FIT IMPRESSION POST · POSTE DE IMPRESIÓN HE FIT



MINI PILAR CÔNICO HE FIT
HE FIT MINI CONICAL ABUTMENT · MINI PILAR CÓNICO HE FIT



PILAR CÔNICO HE FIT
HE FIT CONICAL ABUTMENT · PILAR CÓNICO HE FIT

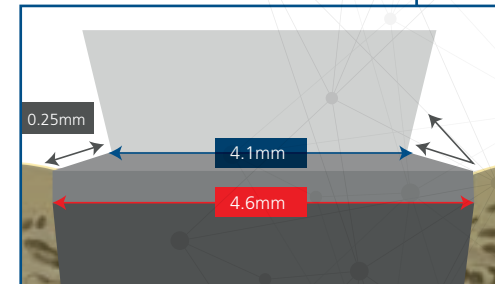

SEQUÊNCIA DIRETA SOBRE IMPLANTE DIRECT SEQUENCE OVER IMPLANT · SECUENCIA DIRECTA SOBRE IMPLANTE


INTEGRA



DUO



ARES

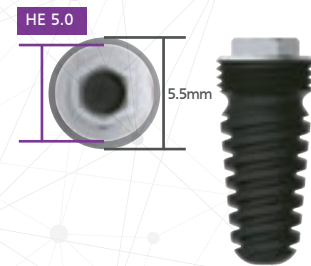

HE 3.3

tapa implante
implant cover
screw
tapa implante

HE 3.3

cicatrizador
healing abutment
cicatrizador

poste de moldagem
impression post
poste de impressão

réplica de implante
implant analog
análogo del implante

ucla
ucla abutment
ucla

OU
munhão especial com preparo
cement-on-crown abutment type
muñón especial con preparo

HE 4.1

tapa implante
implant cover
screw
tapa implante

HE 4.1

cicatrizador
healing abutment
cicatrizador

poste de moldagem
impression post
poste de impresión

réplica de implante
implant analog
análogo del implante

ucla
ucla abutment
ucla

OU
munhão especial com preparo
cement-on-crown abutment type
muñón especial con preparo

HE 5.0

tapa implante
implant cover
screw
tapa implante

HE 5.0

cicatrizador
healing abutment
cicatrizador

poste de moldagem
impression post
poste de impresión

réplica de implante
implant analog
análogo del implante

ucla
ucla abutment
ucla

OU
munhão especial com preparo
cement-on-crown abutment type
muñón especial con preparo

CICATRIZADOR HEALING ABUTMENT · CICATRIZADOR

· Componente em titânio;
· Utilizado para modelar o sulco gengival.

· Titanium components;
· Used to shape gingival sulcus.

· Componente en titânio;
· Utilizado para modelar el surco gingival.



DIVERGENTE AESTHETIC CONTOUR · DIVERGENTE

	H = 2		H = 4			H = 5		H = 6			H = 7	
			Ø5.0mm	Ø6.0mm	Ø7.5mm			Ø5.0mm	Ø6.0mm	Ø7.5mm	Ø5.0mm	
HE 3.3	01.201	01.202	01.203			01.204	01.205					
HE 4.1	01.401	01.402		01.411	01.412	01.413	01.404		01.414	01.415	01.416	01.417
HE 5.0	01.501	01.502	01.503			01.504	01.505					



RETO STRAIGHT · RECTO

	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5	H = 6
HE 3.3	01.206	01.207	01.208	01.209	
HE 4.1	01.406	01.409	01.407	01.410	01.408
HE 5.0	01.506	01.507	01.508	01.509	



HE FIT HE FIT · HE FIT

	H = 2	H = 3	H = 4
HE 3.3	01.220	01.221	01.222
HE 4.1	01.418	01.419	01.420
HE 5.0	01.514	01.515	01.516

POSTE DE MOLDAGEM IMPRESSION POST · POSTE DE IMPRESIÓN

· Componente em aço inoxidável;
· Transfere posição e molde para elaboração da prótese.

· Stainless steel components;
· Transfers position and casting for the making of the prosthesis.

· Componente en acero inoxidable;
· Transfiere la posición del implante o pilar intermedio al modelo de trabajo para elaboración de la prótesis.

MOLDEIRA FECHADA CLOSED TRAY IMPRESSION TECHNIQUE · CUBETA CERRADA



HE HE · HE

HE 3.3	08.201
HE 4.1	08.302
HE 5.0	08.501



HE FIT HE FIT · HE FIT

HE 3.3	08.203
HE 4.1	08.304
HE 5.0	08.503

MOLDEIRA ABERTA OPEN TRAY IMPRESSION TECHNIQUE · CUBETA ABIERTA



HE HE · HE

HE 3.3	08.202
HE 4.1	08.303
HE 5.0	08.502



HE FIT HE FIT · HE FIT

HE 3.3	08.204
HE 4.1	08.305
HE 5.0	08.504

RÉPLICA DE IMPLANTE IMPLANT ANALOG · ANÁLOGO DEL IMPLANTE

· Componente em aço inoxidável;
· Auxilia a confecção da prótese ou planejamento protético.

· Stainless steel component;
· Assists the making of the prosthesis or prosthetic planning.

· Componente en acero inoxidable;
· Auxilia la confección de la prótesis o planificación protésica.







	Curto Short / Curto	
HE 3.3	09.201	
HE 4.1	09.302	09.303
HE 5.0	09.502	

MUNHÃO ESPECIAL COM PREPARO



CEMENT-ON-CROWN ABUTMENT TYPE · MUÑÓN ESPECIAL CON PREPARO

- Componente em titânio; . Titanium component; . Componente en titanio;
- Prótese cimentada; . Cemented prosthesis; . Prótesis cementada;
- Hexagonal. . Hexagonal. . Hexagonal.

HE HE · HE

	H = 1	H = 2	H = 3	Reto H=8 Straight Recto
HE 3.3	03.101	03.102		
HE 4.1	03.201 03.208  03.202 03.209 	03.203 03.210 	03.205 03.211 	
HE 5.0	03.301	03.302	03.303	

ANGULADO ANGLED · ANGULADO

	15°	25°
HE 3.3	03.106	03.107
HE 4.1	03.206 03.212  03.207 03.213 	
HE 5.0	03.306	03.307

HE FIT HE FIT · HE FIT

	H = 1	H = 2	H = 3
HE 3.3	03.129	03.130	03.131
HE 4.1	03.229	03.230	03.231
HE 5.0	03.329	03.330	03.331

PARAFUSO PROTÉTICO PROSTHETIC SCREW · TORNILLO PROTÉSICO

HE 3.3	05.202 	HE 4.1	05.302  05.303 	HE 5.0	05.402 
--------	--	--------	---	--------	--

Torque recomendável: 30N.cm

Recommended torque | Torque recomendable: 30N.cm

MICRO-UCLA METÁLICA METALLIC MICRO-UCLA · MICRO-UCLA METÁLICA

- Componente 100% usinado em CoCr; . 100% - processing component in CoCr metallic alloy; . Componente 100% maquinado en aleación metálica CoCr;
- Sistema de tubo-parafuso. . Screw-Tube System. . Sistema de tubo-tornillo



Universal
Universal | Universal 25,040















Torque recomendável: 15N.cm

Recommended torque | Torque recomendable: 15N.cm

UCLA UCLA ABUTMENT · UCLA














CALCINÁVEL CASTABLE · CALCINABLE

- Componente calcinável para fundição; . Castable component for welding; . Componente calcinable para fundición;
- Prótese cimentada ou parafusada; . Cemented or screwed prosthesis; . Prótesis cementada o atornillada;
- Rotacional para elementos múltiplos; . Rotational for multiple elements; . Rotacional para elementos múltiples;
- Hexagonal para elementos unitários. . Hexagonal for single elements. . Hexagonal para elementos unitarios.

		POM POM · POM	POM INJETADA INJECTED POM · POM INYECTADA
HE 3.3			10.207 
			10.208 
HE 4.1			10.325  10.327 
			10.326  10.328 
HE 5.0			10.507 
			10.508 

TITÂNIO TITANIUM · TITANIO




- Componente em titânio; . Titanium component; . Componente en titanio;
- Utilizada preferencialmente para provisórios. . Used for provisional prosthesis. . Utilizada preferencialmente para provisionales.

HE 3.3		10.203 	
		10.204 	
HE 4.1		10.303  10.309 	
		10.304  10.310 	
HE 5.0		10.403 	
		10.504 	

CALCINÁVEL COM BASE METÁLICA


CASTABLE WITH METALLIC BASE · CALCINABLE CON BASE METÁLICA

- Componente calcinável com base metálica CoCr; . Castable component with CoCr metallic base; . Componente calcinable con base metálica CoCr;
- Metal cerâmico, melhor adaptação. . Ceramic metal, best fit to implant. . Metal cerámico, mejor adaptación.

HE 3.3		10.205 	
		10.206 	
HE 4.1		10.313  10.315 	
		10.314  10.316 	
HE 5.0		10.405 	
		10.506 	

SEQUÊNCIA DE INTERMEDIÁRIO SOB O IMPLANTE

PROSTHETIC INTERMEDIATE SEQUENCE · SECUENCIA DE INTERMEDIARIO BAJO EL IMPLANTE

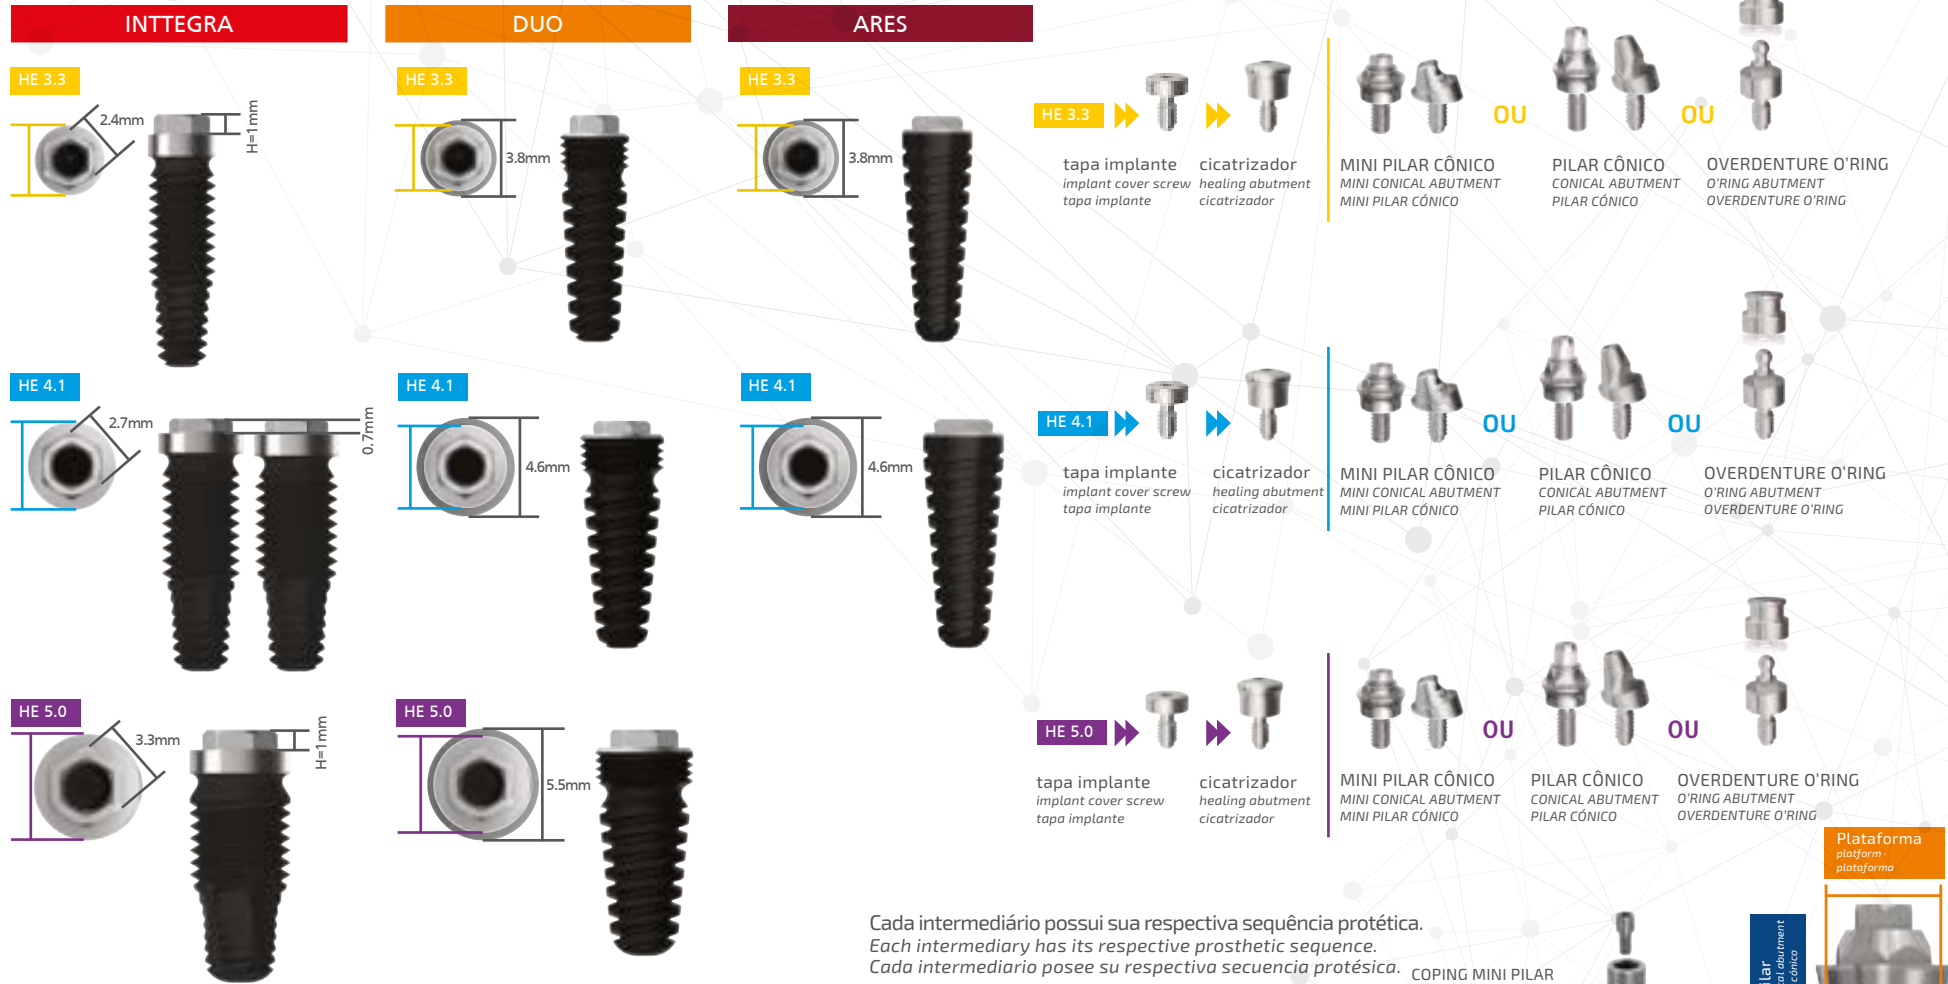

Cada intermediário possui sua respectiva sequência protética.
Each intermediary has its respective prosthetic sequence.
Cada intermediario posee su respectiva secuencia protésica.

SELEÇÃO DO COMPONENTE PROTÉTICO


SELECTION OF PROSTHETIC COMPONENT · SELECCIÓN DE COMPONENTE PROTÉSICO

PRÓTESE MÚLTIPLA / MULTIPLE PROSTHETICS · PRÓTESIS MULTIPLA

mini pilar cônico he / mini conical abutment · mini pilar cônico
mini pilar cônico he / mini conical abutment · mini pilar cônico

PRÓTESE UNITÁRIA / UNIT PROSTHETICS · PRÓTESIS UNITARIA

pilar cônico he / conical abutment · pilar cônico
pilar cônico he / conical abutment · pilar cônico

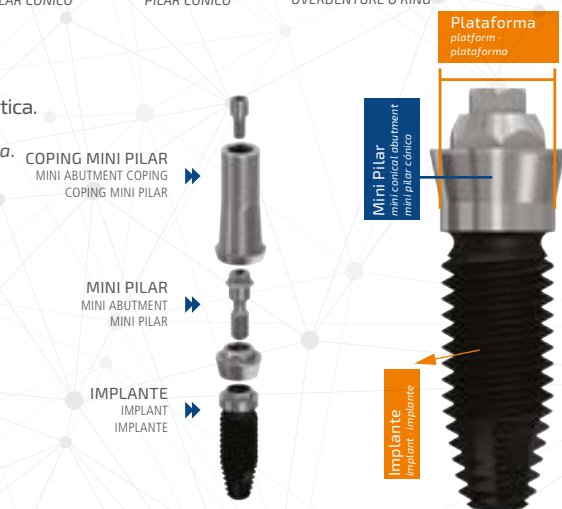

MINI PILAR CÔNICO MINI CONICAL ABUTMENT · MINI PILAR CÓNICO

- Componente em titânio;
- Prótese múltipla e parafusada;
- Espaço mínimo inter-oclusal de 4,5mm e 7,5mm para 17° e 30°.

- Titanium component;
- Multiple and screw retained prosthesis;
- Minimum interocclusal space of 4,5mm and 7,5mm for 17° and 30°.

- Componente em titânio;
- Prótesis múltipla y atornillada;
- Espacio mínimo interoclusal de 4,5mm y 7,5mm para 17° y 30°.

HE HE · HE

	H = 1	H = 2	H = 3	H = 4
HE 3.3	02.211	02.212	02.213	
HE 4.1	02.104	02.105	02.106	02.107
HE 5.0	02.301	02.302	02.303	02.304

Torque recomendável: 30N.cm
Recommended torque | Torque recomendable: 30N.cm

HE FIT HE FIT · HE FIT

	H = 1	H = 2	H = 3	H = 4
HE 3.3	02.215	02.216	02.217	
HE 4.1	02.232	02.233	02.234	02.235

HE 4.1	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5
Peça Única Single Piece Pieza Única	02.120	02.121	02.122	02.123

ANGULADO ANGLED · ANGULADO

	H = 2		H = 3		H = 4	
	17°	17°	30°	17°	30°	
HE 3.3	02.134	02.136	02.138	02.137	02.139	
HE 4.1	02.124	02.125	02.127	02.126	02.135	

HASTE DE INSERÇÃO
STEM INSERTION
VARILLA DE INSERCIÓN

HE 4.1 15.203

PILAR CÔNICO CONICAL ABUTMENT · PILAR CÓNICO

- Componente em titânio;
- Prótese múltipla;
- Espaço mínimo oclusal de 6,7mm, 7,4mm para 17° e 8,5mm para 30°.

- Titanium component;
- Multiple prosthesis;
- Minimum occlusal space of 6,7mm, 7,4mm for 17° and 8,5mm for 30°.

- Componente em titânio;
- Prótesis múltipla;
- Espacio mínimo oclusal de 6,7mm, 7,4mm para 17° y 8,5mm para 30°.

HE HE · HE

	H = 1	H = 2	H = 3	H = 4
HE 3.3	06.201	06.202	06.203	
HE 4.1	06.107	06.108	06.109	06.120
HE 5.0	06.301	06.302	06.303	06.304

HE FIT HE FIT · HE FIT

	H = 1	H = 2	H = 3	H = 4
HE 3.3	06.215	06.216	06.217	
HE 4.1	06.232	06.233	06.234	06.235

HE 4.1	H = 1	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5
Peça Única Single Piece Pieza Única	06.115	06.116	06.117	06.118	06.119

ANGULADO ANGLED · ANGULADO

	H = 2 17°	H = 3 30°
HE 4.1	06.129	06.126

TRANSFER PILAR CÔNICO
CONICAL ABUTMENT IMPRESSION POST
POSTE DE IMPRESIÓN PILAR CÓNICO

Moldeira Fechada
Closed Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Cerrada

06.112

Moldeira Aberta
Open Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Abierta

06.113 06.114

RÉPLICA PILAR CÔNICO
CONICAL ABUTMENT ANALOGUE
ANÁLOGO PILAR CÓNICO

06.110 06.111

CICATRIZADOR PILAR CÔNICO
CONICAL ABUTMENT HEALING CAP
CICATRIZADOR PILAR CÓNICO

06.101

COPING PILAR CÔNICO
CONICAL ABUTMENT COPING · COPING PILAR CÓNICO

Torque recomendável: 10N.cm Recommended torque | Torque recomendable: 10N.cm

Base Metálica CoCr CoCr Metallic Base Base Metálica CoCr	Titânio Titanium Titanio	Curto Short Corto	Calcinável Castable Calcinable	Curto Short Corto
02.128	06.127 06.128	06.122 06.124	06.102 06.104	06.121 06.123

TRANSFER MINI PILAR CÔNICO
MINI CONICAL ABUTMENT IMPRESSION POST
POSTE DE IMPRESIÓN MINI PILAR CÓNICO

Moldeira Fechada
Closed Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Cerrada

02.109

Moldeira Aberta
Open Tray Impression Technique
Impresión Cubeta Abierta

02.110

Parafuso do Transfer
Impression Post Screw
Tornillo del Poste de Impresión

02.190

RÉPLICA MINI PILAR CÔNICO
MINI CONICAL ABUTMENT ANALOGUE
ANÁLOGO MINI PILAR CÓNICO

02.108

CICATRIZADOR MINI PILAR CÔNICO
NARROW MINI CONICAL ABUTMENT HEALING CAP
CICATRIZADOR ESTRECHO MINI PILAR CÓNICO

02.207

ESTREITO

02.103

NORMAL

COPING MINI PILAR CÔNICO
MINI CONICAL ABUTMENT COPING · COPING MINI PILAR CÓNICO

Torque recomendável: 10N.cm Recommended torque | Torque recomendable: 10N.cm

Base Metálica CoCr CoCr Metallic Base Base Metálica CoCr	Curto Cobalto Cromo CoCr Short Corto Cromo Cobalto	Titânio Titanium Titanio	Calcinável Castable Calcinable	Calcinável POM POM Castable Calcinable POM
02.128	02.129	02.101	02.102	02.112

OVERDENTURE O´RING DIRETO O´RING ABTMENT · OVERDENTURE O´RING

- . Componente em titânio;
- . Parafusado direto ao implante;
- . Prótese overdenture;
- . Sistema Attachment Bola.

- . Titanium component;
- . Screwed directly into the implant;
- . Overdenture prosthesis;
- . Attachment System.

- . Componente en titanio;
- . Tornillo directo al implante;
- . Prótesis overdenture;
- . Sistema de retención.



	H = 2	H = 3	H = 4	H = 5	H = 6
HE 3.3	04.111	04.112	04.113	04.114	04.115
HE 4.1	04.201	04.202	04.203	04.204	04.205
HE 5.0	04.301	04.302	04.303	04.304	04.305



CHAVE PARA O´RING
O´RING DRIVER
LLAVE PARA O´RING



CÁPSULA DE O´RING COM ANEL POSICIONADO
O´RING METAL CAPSULE WITH RUBBER RING
CÁPSULA DE O´RING CON ANILLO POSICIONADO

04.306



ANEL DE REPOSIÇÃO PARA CÁPSULA DE O´RING (BORRACHA)
RUBBER RING FOR O´RING CAPSULE REPLACEMENT
ANILLO DE REPOSICIÓN PARA CÁPSULA DE O´RING (GOMA)

04.307



OVERDENTURE O´RING CALCINÁVEL (MACHO)
CASTABLE O´RING ABUTMENT OVERDENTURES
OVERDENTURE O´RING CALCINABLE

04.360



ANEL PLÁSTICO ESPAÇADOR DE O´RING
O´RING SPACER PLASTIC RING
ANILLO PLÁSTICO ESPAÇADOR DE O´RING

04.308




CÁPSULA PLÁSTICA DE O´RING
O´RING PLASTIC CAPSULE (IMPRESSION)
CÁPSULA PLÁSTICA DE O´RING

04.309


ACESSÓRIOS PROTÉTICOS

PROSTHETIC ACCESSORIES · ACCESORIOS PROTÉSICOS

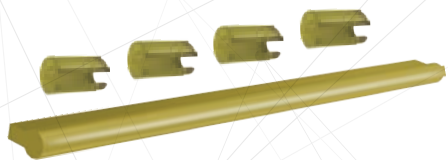

BARRA CLIP (AMARELA)
EDS BAR (YELLOW) | BARRA (AMARILLA)

CLIP FINAL (NYLON AMARELA)
FINAL CLIP (YELLOW NYLON) | CLIP FINAL (NYLON AMARILLO)

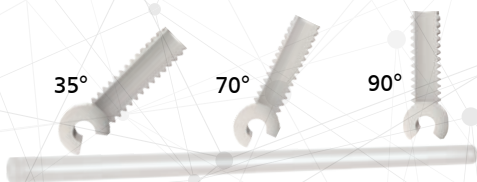

BARRA CLIP FINAL (BRANCO)
FINAL BAR CLIP (WHITE) | BARRA CLIP FINAL (BLANCA)

26.008

CLIP FINAL (BRANCO) FINAL CLIP (WHITE) | CLIP FINAL (BLANCO)

35°	26.009	70°	26.010	90°	26.011
-----	--------	-----	--------	-----	--------



DISPOSITIVO PROLONGADOR DE CILINDRO PROVISÓRIO
EXTENSION DEVICE WITH PROVISIONAL CYLINDER
DISPOSITIVO DE PROLONGACIÓN DE CILINDRO PROVISORIO

5mm	20.101
15mm	20.102



DISPOSITIVO PROLONGADOR BILATERAL DE UCLA/COPING
BILATERAL EXTENSION DEVICE (UCLA / COPING)
DISPOSITIVO DE PROLONGACIÓN BILATERAL (UCLA / COPING)

10mm	20.103
------	--------

**COMPONENTES
PROTÉTICOS DIGITAIS**


DIGITAL PROSTHETIC COMPONENTS
COMPONENTES PROTÉTICOS DIGITALES

**SEJA
VOCÊ**




1

Realização de moldagem convencional e escaneamento do modelo de gesso em laboratório para confecção das peças seguindo fluxo digital.

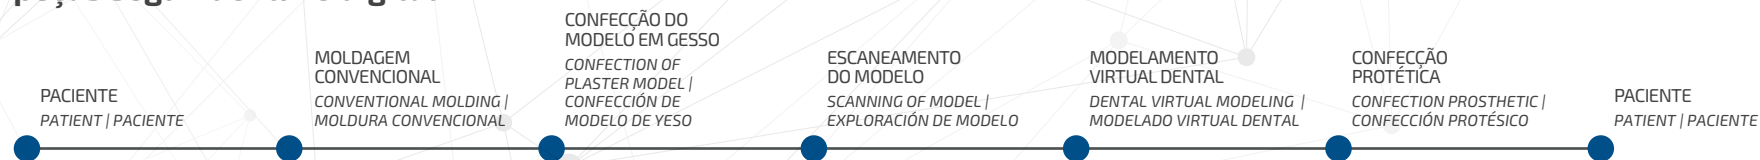

2

Fluxo 100% digital, com escaneamento intraoral, impressão de modelo com análogos digitais, modelamento dental em CAD e fabricação da peça em equipamento CAM;

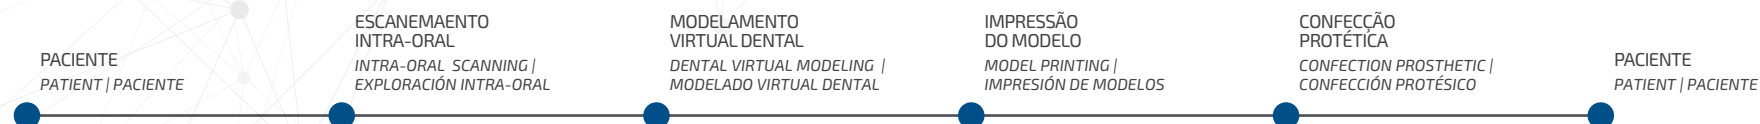

3

Fluxo 100% digital chairside (para cirurgiões-dentistas que possuem sistema CAD/CAM completo) com escaneamento intra-oral, desenho das peças no CAD e fresagem.



BASE DE TITÂNIO TITANIUM BASE · BASE DE TITANIO

. Componente em titânio;
. Utilizado para modelar
o sulco gengival.

. Titanium components;
. Used to shape gingival sulcus.

. Componente en titanio;
. Utilizado para modelar el surco gingival.



HEXAGONAL HEXAGONAL · HEXAGONAL

	H = 1	H = 2	H = 3	H = 4
HE FIT 3.3	11.201	11.202	11.203	
HE FIT 4.1	11.301	11.302	11.303	11.304
HE FIT 5.0	11.401	11.402	11.403	11.404



ROTACIONAL ROTATIONAL · ROTACIONAL

	H = 1	H = 2	H = 3	H = 4
HE FIT 3.3	11.205	11.206	11.207	
HE FIT 4.1	11.305	11.306	11.307	11.308
HE FIT 5.0	11.405	11.406	11.407	11.408



CM CM · CM

	H = 1	H = 1,5	H = 2	H = 2,5	H = 3	H = 4	H = 4,5
Ø3.5MM	11.231	11.232	11.233	11.234	11.235	11.236	11.237
Ø4.5MM	11.238	11.239	11.240	11.241	11.242	11.243	11.244

DUOCON 4.6-5.5MM

DUOCON 4.6-5.5MM · DUOCON 4.6-5.5MM

	H = 1	H = 2	H = 4
Ø4.5MM	11.331	11.332	11.333
Ø5.5MM	11.334	11.335	11.336

TRANSFERS TRANSFERS · TRANSFERS

. Componente em aço inoxidável;
. Auxilia a confecção da prótese ou planejamento protético.

. Stainless steel component;
. Assists the making of the prosthesis or prosthetic planning.

. Componente en acero inoxidable;
. Auxilia la confección de la prótesis o planificación protésica.



HE FIT 3.3	11.209
HE FIT 4.1	11.331
HE FIT 5.0	11.409



CM	11.248
----	--------



DUOCON	11.348
--------	--------

RÉPLICA DE IMPLANTE IMPLANT ANALOG · ANÁLOGO DEL IMPLANTE

. Componente em aço inoxidável;
. Auxilia a confecção da prótese ou planejamento protético.

. Stainless steel component;
. Assists the making of the prosthesis or prosthetic planning.

. Componente en acero inoxidable;
. Auxilia la confección de la prótesis o planificación protésica.



HE FIT 3.3	09.701
HE FIT 4.1	09.702
HE FIT 5.0	09.703



CM	09.704
----	--------



DUOCON	09.705
--------	--------

EVO

SEJA
VOCÊ



A Linha EVO se destaca no mercado por oferecer um design diferenciado, mais praticidade e funcionalidade.

The Evo stands out in the market by having a distinctive design and provide more convenience and functionality.

El Evo se destaca en el mercado por tener un diseño distintivo y proporcionar una mayor comodidad y funcionalidad.



KIT CIRÚRGICO SURGICAL KIT . KIT QUIRÚRGICO

Para todos os implantes Signo Vinces®

For all implants Signo Vinces®

Para todos los implantes Signo Vinces®



KIT GUIDE GUIDE KIT . KIT GUIDE

Para cirurgia guiada dos implantes Signo Vinces®

For guided surgery of Signo Vinces® implants

Para cirugía guiada de implantes Signo Vinces®



KIT GUIAS CIRÚRGICAS

SURGICAL GUIDES KIT . KIT GUÍAS QUIRÚRGICAS



KIT DE ENXERTO | ANCORAGEM

*BONE GRAFTING KIT | ANCHORAGE
KIT DE ENJERTO | ANCLAJE*



KIT PROTÉTICO


PROSTHETIC KIT . KIT PROTÉSICO

KIT CIRÚRGICO EVO EVO SURGICAL KIT · KIT QUIRÚRGICO EVO

. Compacto, prático e funcional;
 . Estojo autoclavável;
 . Para todos os implantes Signo Vinces.

. Compact, practical and functional;
 . Autoclavable case;
 . For all Signo Vinces implants.

. Compacto, práctico y funcional;
 . Estuche autoclavable;
 . Para todos los implantes Signo Vinces.

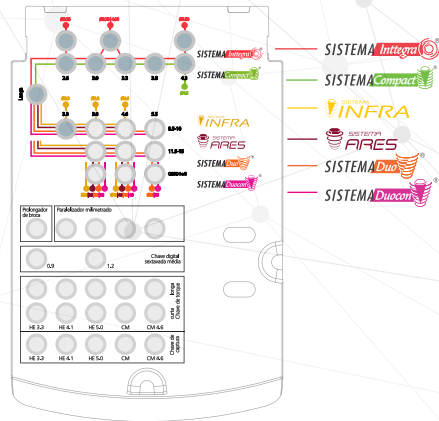

Personalize seus Kits: Selecione as peças de acordo com a sua necessidade.
 Customize your Kit: Select the equipment according to your needs.
 Personalice su Kit: Seleccione las piezas de acuerdo con su necesidad.

	Kit Cirúrgico EVO	EVO Surgical Kit	Kit Quirúrgico EVO
20.502	Kit Cirúrgico EVO	EVO Surgical Kit	Kit Quirúrgico EVO
20.552	Estojo Autoclavável para Kit Cirúrgico Evo	Autoclavable Case for Evo Surgical Kit	Estuche Esterilizable en Autoclave para Kit quirúrgico Evo
16.211	Broca Lança Helicoidal	Helical Pointed Start Drill	Fresa Lanza Helicoidal
16.214	Broca Helicoidal 2.6mm	Helical Drill 2.6mm	Fresa Helicoidal 2.6mm
16.217	Broca Helicoidal 3.0mm	Helical Drill 3.0mm	Fresa Helicoidal 3.0mm
16.220	Broca Helicoidal 3.3mm	Helical Drill 3.3mm	Fresa Helicoidal 3.3mm
16.223	Broca Helicoidal 3.8mm	Helical Drill 3.8mm	Fresa Helicoidal 3.8mm
16.226	Broca Helicoidal 4.3mm	Helical Drill 4.3mm	Fresa Helicoidal 4.3mm
16.208	Broca Sistema Infra 3.3mm 8.5-15.0	Infra System Drill 3.3mm 8.5-15.0	Fresa Sistema Infra 3,3 mm 8.5-15,0
16.201	Broca Sistema Duo 3.8mm 8.5-10.0	Duo System Drill 3.8mm 8.5-10.0	Fresa Sistema Duo 3.8mm 8.5-10.0
16.202	Broca Sistema Duo 3.8mm 11.5-15.0	Duo System Drill 3.8mm 11.5-15.0	Fresa Sistema Duo 3.8mm 11.5-15.0
16.203	Broca Sistema Duo 4.6mm 8.5-10.0	Duo System Drill 4.6mm 8.5-10.0	Fresa Sistema Duo 4.6mm 8.5-10.0
16.204	Broca Sistema Duo 4.6mm 11.5-15.0	Duo System Drill 4.6mm 11.5-15.0	Fresa Sistema Duo 4.6mm 11.5-15.0
16.205	Broca Sistema Duo 5.5mm 8.5-10.0	Duo System Drill 5.5mm 8.5-10.0	Fresa Sistema Duo 5,58mm 8.5-10.0
16.206	Broca Sistema Duo 5.5mm 11.5-15.0	Duo System Drill 5.5mm 11.5-15.0	Fresa Sistema Duo 5.5mm 11.5-15.0
16.230	Broca Countersink 3.3-2.6mm	Countersink Drill 3.3-2.6mm	Fresa Countersink 3.3-2.6mm
16.231	Broca Countersink 4.1-3.0mm	Countersink Drill 4.1-3.0mm	Fresa Countersink 4,1-3.0mm
16.233	Broca Countersink 5.0-4.3mm	Countersink Drill 5.0-4.3mm	Fresa Countersink 5.0-4.3mm
16.258	Broca Countersink Sistema Duo-Duocon 3.8mm	Duo-Duocon Countersink System Drill 3.8mm	Fresa Countersink Sistema Duo-Duocon 3.8mm
16.256	Broca Countersink Sistema Duo-Duocon 4.6mm	Duo-Duocon Countersink System Drill 4.6mm	Fresa Countersink Sistema Duo-Duocon 4.6mm
16.257	Broca Countersink Sistema Duo-Duocon 5.5mm	Duo-Duocon Countersink System Drill 5.5mm	Fresa Countersink Sistema Duo-Duocon 5.5mm
20.317	Paralelizador Milimetrado (4unid)	Parallelism Device in Millimeters (4unit)	Dispositivo de Paralelismo Milimetrado (4unid)
20.311	Prolongador de Brocas	Drill Extensor	Prolongador de Fresas
15.301	Chave Torque Interna 3.3mm para Contra-ângulo	Internal Torque Driver 3.3mm for Contra-angle	Llave Torque Interno 3.3mm para Contra-angulo
15.302	Chave Torque Interna 4.1mm para Contra-ângulo	Internal Torque Driver 4.1mm for Contra-angle	Llave Torque Interno 4.1mm para Contra-angulo
15.303	Chave Torque Interna 5.0mm para Contra-ângulo	Internal Torque Driver 5.0mm for Contra-angle	Llave Torque Interno 5.0mm para Contra-angulo
15.304	Chave de Torque Interno 3.3mm Curta para Torquímetro	Short Internal Torque Driver 3.3mm for Torque Wrench	Llave Torque Interno Corta 3.3mm para Torquímetro
15.306	Chave de Torque Interno 4.1mm Curta para Torquímetro	Short Internal Torque Driver 4.1mm for Torque Wrench	Llave Torque Interno Corta 4.1mm para Torquímetro
15.308	Chave de Torque Interno 5.0mm Curta para Torquímetro	Short Internal Torque Driver 5.0mm for Torque Wrench	Llave Torque Interno Corta 5.0mm para Torquímetro
15.305	Chave de Torque Interno 3.3mm Longa para Torquímetro	Long Internal Torque Driver 3.3mm for Torque Wrench	Llave Torque Interno Larga 3.3mm para Torquímetro
15.307	Chave de Torque Interno 4.1mm Longa para Torquímetro	Long Internal Torque Driver 4.1mm for Torque Wrench	Llave Torque Interno Larga 4.1mm para Torquímetro
15.309	Chave de Torque Interno 5.0mm Longa para Torquímetro	Long Internal Torque Driver 5.0mm for Torque Wrench	Llave Torque Interno Larga 5.0mm para Torquímetro
15.360	Chave de Captura CM	Capture Driver CM	Llave de Captura CM
15.361	Chave Duocon 4.6-5.5mm para Contra-ângulo	Duocon 4.6-5.5mm Capture for Contra-Angle	Llave de Captura Duocon 4.6-5.5cm
15.312	Chave de Torque CM Curta	Torque Driver CM Short	Llave de Torque CM Corta
15.314	Chave Duocon Curta 4.6-5.5mm para Contra-ângulo	Duocon Short Capture 4.6-5.5mm for Contra-Angle	Llave de Torque CM 4.6 Corta
15.313	Chave de Torque CM Longa	Torque Driver CM Long	Llave de Torque CM Larga
15.315	Chave Duocon Longa 4.6-5.5mm para Contra-ângulo	Duocon Long Capture 4.6-5.5mm for Contra-Angle	Llave de Torque CM 4.6 Larga
15.102	Chave Digital Sextavada 0.9mm Média	Hex Digital Driver 0.9mm Medium	Llave Digital Sextavada 0.9mm Mediana
15.104	Chave Digital Sextavada 1.2mm Média	Hex Digital Driver 1.2mm Medium	Llave Digital Sextavada 1.2mm Mediana
20.304	Torquímetro Cirúrgico	Surgical Torque Wrench	Torquímetro Quirúrgico

BROCAS DRILL · FRESA


BROCA LANÇA HELICOIDAL

HELICOIDAL POINTED START DRILL · FRESA LANSA HELICOIDAL

- . Ponta de lança para rompimento da cortical;
- . Corpo helicoidal escalonada 2.0-2.5mm para início de instrumentação dos implantes.

. Pointed drill to initial cortical perforation;
 . Staged spiral body 2.0-2.5mm for first instrumentation of implants.


. Freza lanceolada para romper el hueso cortical;
 . Cuerpo helicoidal con escalonamiento 2.0-2.5mm para inicio de instrumentación de implantes.



2.0-2.5mm 16.211

BROCA CILÍNDRICA CILINDRICAL DRILL · FRESA CILINDRICA

- . Gravação a laser das profundidades para instalação do implante;
- . Laser marked with implant measures;
- . Grabación a laser de las profundidades para instalación de implantes;




2.6mm	16.214
3.0mm	16.217
3.3mm	16.220
3.8mm	16.223
4.3mm	16.226

BROCA SISTEMA INFRA E DUO INFRA AND DUO SYSTEM DRILL · FRESA SISTEMA INFRA Y DUO

- . Gravação a laser das profundidades para instalação do implante;
- . Comprimentos: broca para implantes de 8.5-10.0mm e de 11.5-15.0mm.

. Laser marked with implant measures;
 . Lengths: 8.5 and 10mm implant drill and 11.5/13/15mm implant drill.

. Grabación a laser de las profundidades pra instalación de implantes;
 . Fresas para implantes de 8.5 e 10mm y fresas para implantes de 11.5/13/15mm.



8.5-15.0	16.208
3.3mm	16.208

	8.5-10.0	11.5-15.0
3.8mm	16.201	16.202
4.6mm	16.203	16.204
5.5mm	16.205	16.206

BROCA COUNTERSINK COUNTERSINK DRILL · FRESA COUNTERSINK

- . Preparo da crista óssea para assentamento do terço cervical dos implantes 3.25, 3.75, 4.0, 5.0mm;

. Bone crest preparation to fit the implant neck 3.25, 3.75, 4.0, 5.0mm;

. Preparación del hueso crestral para la adaptación del cuello del implante 3.25, 3.75, 4.0, 5.0mm;



3.3mm	16.230
4.1mm	16.231
5.0mm	16.233

BROCA COUNTERSINK COUNTERSINK DRILL · FRESA COUNTERSINK

- . Preparo da crista óssea para assentamento do terço cervical dos implantes 3.8, 4.6, 5.5mm;

. Bone crest preparation to fit the implant neck 3.8, 4.6, 5.5mm;

. Preparación del hueso crestral para la adaptación del cuello del implante 3.8, 4.6, 5.5mm;



3.8mm	16.258
4.6mm	16.256
5.5mm	16.257

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

SURGICAL INSTRUMENTS · INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS

PARALELIZADORES MILIMETRADOS

PARALLELISM DEVICE IN MILLIMETERS · DISPOSITIVO DE PARALELISMO MILIMETRADO

- . Guia milimetrada de direção das perfurações e análise das profundidades.

. Direction guide in millimeters for drillings and depth analysis.

. Guía milimetrada de dirección para perforaciones y análisis de profundidades.

20.317



PROLONGADOR DE BROCA DRILL EXTENSOR · PROLONGADOR DE FRESAS

- . Sistema de troca e aperto rápido das brocas;
- . Comprimento: 39mm.

. Easy to change and fix system; . Sistema de cambio y fijación;
 . Lengths: 39mm. . Largo: 39mm.

20.311



PROFUNDÍMETRO DUOCON DUOCON GINGIVAL GAUGE · PROFUNDÍMETRO DUOCON

- . Seleciona o componente protético Duocon;
- . Marcação a laser para medição da profundidade gengival correspondente às alturas de trans-mucoso.

. Helps select the Duocon prosthetic components;
 . Laser market with different abutment lengths.

. Selecciona el componente protésico Duocon;
 . Marcación a laser de la profundidad gengival.

3.8mm	10mm	20.315
-------	------	--------



4.6/5.5mm	10mm	20.316
-----------	------	--------



TORQUÍMETRO TORQUE WRENCH · TORQUÍMETRO

- . Sistema de torque reverso com simples giro no anel de reversão (180°).

. Reverse torque system with a simple turn.

. Sistema de torque reversible con simple giro del anillo de reversión.



Protético Prosthetic / Protésico	20.301
----------------------------------	--------

Cirúrgico Surgical / Quirúrgico	20.304
---------------------------------	--------

CHAVE DE CAPTURA CAPTURE DRIVER · LLAVE DE CAPTURA



HE HE HE	Curto Short Corto
3.3mm	15.301 15.316
4.1mm	15.302 15.317
5.0mm	15.303 15.318



CM CM CM	Longo Long Larga
CM	15.360 15.369
4.6mm	15.361

CHAVE DIGITAL DIGITAL DRIVER · LLAVE DIGITAL



SEXTAVADA HEX SEXTAVADA Média Medium Mediana	0.9mm	1.2mm
	15.102	15.104

CHAVE DE TORQUE TORQUE DRIVER · LLAVE DE TORQUE



HE HE HE	Curto Short Corto	Longo Long Larga
3.3mm	15.304	15.305
4.1mm	15.306	15.307
5.0mm	15.308	15.309



CM CM CM	Curto Short Corto	Longo Long Larga
CM	15.312	15.313
4.6mm	15.314	15.315

SONDA MILIMETRADA CAPTURE DRIVER · LLAVE DE CAPTURA



20.306

KIT EVO GUIDE EVO GUIDE KIT · KIT EVO GUIDE

- Compacto, prático e funcional;
 - Estojo autoclavável;
 - Para cirurgia guiada.
-
- *Compact, practical and functional;*
 - *Autoclavable case;*
 - *For guided surgery*
-
- *Compacto, práctico y funcional;*
 - *Estuche autoclavable;*
 - *Para cirugía guiada*



Sistema Infra CM - Plataformas 3.3/3.8/4.6 | Duocon CM - Plataforma 3.8 | Sistema Duo e Ares HE - Plataformas 3.3 /4.1

	Kit EVO Guide	EVO Guide Kit	Kit Guide EVO
15.320	Chave Evo Guide para Contra Ângulo Torque Interno 3.3mm	Evo Guide Wrench for 3.3mm Internal Torque Counter-Angle	Evo Guide Wrench para Contra-Ângulo de Torque Interno de 3.3mm
15.321	Chave Evo Guide para Contra Ângulo Torque Interno 4.1mm	Evo Guide Wrench for 4.1mm Internal Torque Counter-Angle	Evo Guide Wrench para Contra-Ângulo de Torque Interno de 4.1mm
15.322	Chave Evo Guide Torque Interno 3.3mm para Torquímetro	Evo Guide 3.3mm Internal Torque Key for Torque Wrench	Evo Guide Llave Dinamométrica Interna de 3.3mm para Llave Dinamométrica
15.323	Chave Evo Guide Torque Interno 4.1mm para Torquímetro	Evo Guide 4.1mm Internal Torque Key for Torque Wrench	Evo Guide Llave Dinamométrica Interna de 4.1mm para Llave Dinamométrica
15.324	Chave Evo Guide de Captura CM	Evo Guide CM Capture Key	Llave de Captura Evo Guide CM
15.326	Chave Evo Guide de Torque CM	Evo Guide Torque Wrench CM	Llave Dinamométrica Evo Guide CM
16.285	Broca Cilíndrica Evo Guide 1.3	Cylindrical Drill Evo Guide	Taladro Cilíndrico Evo Guide
16.286	Broca Cortical Evo Guide	Evo Guide Cortical Drill	Cerradero Cilíndrico Evo Guide
16.287	Broca Lança Evo Guide	Drill Spear Evo Guide	Drill Lanza Evo Guide
16.288	Broca Cônica 3.3mm 8.5 - 13.0 Evo Guide	Conical Drill Dit 3.3mm 8.5 - 13.0 Evo Guide	Broca Cônica 3.3mm 8.5 - 13.0 Evo Guide
16.289	Broca Cônica 3.8mm 8.5 - 10.0 Evo Guide	Conical Drill Bit 3.8mm 8.5 - 10.0 Evo Guide	Broca Cônica 3.3mm 8.5 - 13.0 Evo Guide
16.290	Broca Cônica 3.8mm 8.5 - 13.0 Evo Guide	Conical Drill Bit 3.8mm 8.5 - 13.0 Evo Guide	Broca Cônica 3.8mm 8.5 - 13.0 Evo Guide
16.291	Broca Cônica 4.6mm 8.5 - 10.0 Evo Guide	Conical Drill Bit 4.6mm 8.5 - 10.0 Evo Guide	Broca Cônica 4.6 mm 8.5 - 10.0 Evo Guide
16.292	Broca Cônica 4.6mm 11.5 - 13.0 Evo Guide	Conical Drill Bit 4.6mm 11.5 - 13.0 Evo Guide	Broca Cônica 4.6mm 11.5 - 13.0 Evo Guide
16.293	Broca Piloto 3.8mm Evo Guide	Pilot Drill 3.8mm Evo Guide	Fresa Piloto 3.8mm Evo Guide
16.294	Broca Piloto 4.6mm Evo Guide	Pilot Drill 4.6mm Evo Guide	Fresa Piloto 4.6mm Evo Guide
16.295	Extrator Mucosa Evo Guide	Mucous Extract Evo Guide	Guía Evo Extracto Mucoso
20.420	Fixador de Guia Cirúrgico Evo Guide	Surgical Guide Fixator Evo Guide	Guía Quirúrgica Fixator Evo Guide
20.434	Estabilizador de Guia Evo Guide M1.6 alt. 9.0	Guide Extractor Evo Guide M1.6 alt. 9.0	Guía Extractora Evo Guide M1.6 alt. 9.0
20.435	Estabilizador de Guia Evo Guide M1.8 alt. 9.0	Guide Extractor Evo Guide M1.8 alt. 9.0	Guía Extractora Evo Guide M1.8 alt. 9.0
20.436	Estabilizador de Guia Evo Guide M2.0 alt. 9.0	Guide Extractor Evo Guide M2.0 alt. 9.0	Extractor de Guías Evo Guide M2.0 alt. 9.0
20.439	Estabilizador de Guia Evo Guide M1.8 alt. 11.0	Guide Extractor Evo Guide M1.8 alt. 11.0	Guía Extractora Evo Guide M1.8 alt. 11.0
20.440	Estabilizador de Guia Evo Guide M2.0 alt. 11.0	Guide Extractor Evo Guide M2.0 alt. 11.0	Extractor de Guías Evo Guide M2.0 alt. 11.0
20.559	Estojo Autoclavo para Kit Evo Guide	Autoclave Case for Evo Guide Kit	Estuche Autoclave para Evo Guide Kit
15.102	Chave Digital Sextavada 0.9mm Médio	0.9mm Medium Hex Digital Wrench	Llave Digital Hexagonal Mediana de 0.9mm
15.104	Chave Digital Sextavada 1.2mm Médio	1.2mm Medium Hex Digital Wrench	Llave Digital Hexagonal Mediana de 1.2mm
20.304	Torquímetro Cirúrgico	Surgical Torque Wrench	Llave Dinamométrica Quirúrgica

* Estes itens fazem parte do kit EVO GUIDE, são vendidas ao dr./laboratório e usadas na confecção do guia cirúrgico e a quantidade de peças depende do planejamento cirúrgico.

Personalize seus Kits: Selecione as peças de acordo com a sua necessidade.
 Customize your Kits: Select the equipment according to your needs.
 Personalice sus Kits: Seleccione las piezas de acuerdo con tu necesidad.

BROCAS DRILL · FRESA

BROCA CILÍNDRICA EVO GUIDE

EVO GUIDE CYLINDRICAL DRILL · FRESA CILÍNDRICA EVO GUIDE

- Preparo para o Fixador do Guia Cirúrgico;
- Corpo cilíndrico 1.3mm para estabilizar o guia cirúrgico.
- Preparation for the Surgical Guide Fixer;
- Cylindrical body of 1.3 mm to stabilize the surgical guide.
- Preparación para el fijador guía quirúrgico;
- Cuerpo cilíndrico de 1,3 mm para estabilizar la guía quirúrgica.



1.3mm 16.285

BROCA CORTICAL EVO GUIDE

EVO GUIDE CORTICAL DRILL · FRESA CORTICAL EVO GUIDE

- Romper a cortical do osso utilizando o guia cirúrgico;
- Ponta helicoidal curta de 2.0mm antes da broca lança.
- Break through the cortical bone using the surgical guide;
- Short 2.0mm helical tip before start drill.
- Rompa el hueso cortical usando la guía quirúrgica;
- Punta helicoidal corta de 2,0 mm antes da Fresa lanza



1.3mm 16.286

BROCA LANÇA EVO GUIDE

EVO GUIDE POINTED START DRILL · FRESA LANSA EVO GUIDE

- Primeira perfuração do leito ósseo;
- Corpo helicoidal escalonada 2.0-2.5mm para dar o vetor de posição e profundidade do implante.
- Possui marcações de altura para instalação dos implantes.
- First perforation of the bone bed.
- Helical body staggered 2.0-2.5mm to give implant position and depth vector.
- It has height markings for implant installation.
- Primera perforación del lecho óseo.
- Cuerpo helicoidal escalonado 2,0-2,5 mm para proporcionar la posición y el vector de profundidad.
- Tiene marcas de altura para la instalación del implante.



2.0-2.5mm 16.287

BROCA CÔNICA EVO GUIDE

EVO GUIDE CÔNICAL DRILL · FRESA CONICA EVO GUIDE

- Preparo do alvéolo cirúrgico para colocação dos implantes.
- Comprimentos: Broca para Implantes 8.5-10.0mm e 11.5-13.0mm.
- Possui marcações de altura para instalação dos implantes.
- Preparation of the surgical alveolus for implant placement;
- Lengths: Drill for Implants 8.5-10.0mm and 11.5-13.0mm;
- It has height markings for implant installation.
- Preparación del alvéolo quirúrgico para la colocación de implantes;
- Longitudes: Fresa para Implantes 8.5-10.0mm y 11.5-13.0mm;
- Tiene marcas de altura para la instalación del implante.



		8.5-1
	3.3mm	16.288
	8.5-10.0	8.5-13.0
3.8mm	16.289	16.290
	8.5-10.0	11.5-13.0
4.6mm	16.291	16.292

BROCA PILOTO EVO GUIDE EVO GUIDE PILOT DRILL · FRESA PILOTO EVO GUIDE

- Preparo da crista óssea para assentamento do terço cervical dos Implantes Duo, Duocon, Infra e Ares.
- Possui marcações de altura para instalação dos implantes.
- Bone crest preparation to fit the neck of Duo, Duocon, Infra and Ares implants
- It has height markings for implant installation
- Preparación de la cresta ósea para la colocación del tercio cervical de los implantes Duo, Duocon, Infra y Ares
- Tiene marcas de altura para instalar los implantes.



3.8mm 16.293
4.1mm 16.294

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

SURGICAL INSTRUMENTS · INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS

ANILHA

SLEEVE · CASQUILLOS GUÍA



20.421

ANILHA DO FIXADOR

FIXATION SLEEVE · CASQUILLO DEL FIJADOR



20.425

ESTABILIZADOR DE GUIA EVO GUIDE

GUIDE STABILIZER EVO GUIDE · ESTABILIZADOR DE GUIA EVO GUIDE

- Utilizado para ancorar o Guia Cirúrgico nos implantes.
- Possui um modelo de acordo com cada implante a ser instalado.
- Used to anchor the Surgical Guide to the implants.
- It has a model according to each implant to be installed.
- Sirve para anclar la Guía Quirúrgica a los implantes.
- Dispone de un modelo en correspondencia con cada implante a instalar.



M1.6 alt 90	M1.8 alt 90	M2.0 alt 90
20.434	20.435	20.436

EXTRATOR MUCOSA EVO GUIDE

EVO GUIDE MUCOUS EXTRACTOR · EXTRACTOR DE MUCOSAS GUÍA EVO

- Fazer uma incisão circular na mucosa removendo somente o tecido gengival onde receberá o implante.
- Make a circular incision in the mucosa, removing only the gum tissue where the implant will be placed.
- Realice una incisión circular en la mucosa eliminando únicamente el tejido gingival donde se colocará el implante.

16.295



FIXADOR DE GUIA CIRÚRGICO

SURGICAL GUIDE FIXER · FIJADOR DE GUIA QUIRURGICA

- Instrumento com uma ponta ativa para ancorar no osso e dar estabilidade inicial para o Guia Cirúrgico.
- Instrument with an active tip for anchoring in bone and providing initial stability for the Surgical Guide..
- Instrumento con punta activa para anclar en el hueso y dar estabilidad inicial a la Guía Quirúrgica..

20.420



TORQUÍMETRO TORQUE WRENCH · TORQUÍMETRO

- Sistema de torque reverso com simples giro no anel de reversão (180°).
- Reverse torque system with a simple turn.
- Sistema de torque reversible con simple giro del anillo de reversión.

Protético
Prosthetic I Protésico

20.301

Cirúrgico
Surgical I Quirúrgico

20.304



CHAVE EVO GUIDE EVO GUIDE DRIVER · LLAVE EVO GUIDE

PARA CONTRA ÂNGULO TORQUE INTERNO
INTERNAL TORQUE COUNTER ANGLE
CONTRA-ÂNGULO DE TORQUE

3.3mm	4.1mm
15.320	15.321



TORQUE INTERNO PARA TORQUÍMETRO
INTERNAL TORQUE | TORQUE INTERNO

3.3mm	4.1mm
15.322	15.323



DE CAPTURA
CAPTURE | CAPTURA

15.324



DE TORQUE
TORQUE | TORQUE

15.326



CHAVE DIGITAL DIGITAL DRIVER · LLAVE DIGITAL

SEXTAVADA HEX SEXTAVADA Média Medium Mediana	
0.9mm	1.2mm
15.102	15.104



KIT DE GUIA CIRÚRGICA SURGICAL GUIDE KIT · KIT GUÍA QUIRÚRGICA

- . Estojo autoclavável;
- . Kit completo de ferramentas para o diagnóstico de espaços biológicos peri-implantares e entre dentes e implantes.

- . Autoclavable Case;
- . Complete kit of tools for the diagnosis of biological peri implant spaces between teeth and implants.

- . Estuche autoclavable;
- . Kit completo de herramientas de diagnóstico de espacios biológicos peri-implantares y espacios entre dientes e implantes.

Personalize seus Kits: Selecione as peças de acordo com a sua necessidade.

Customize your Kit: Select the equipment according to your needs. | Personalice su Kit: Seleccione las piezas de acuerdo con su necesidad.

20.504	Kit de Guia Cirúrgica EVO	EVO Surgical Guide Kit	Kit Guia Quirúrgica EVO
25.504	Caixa Autoclavável para Kit de Guia Cirúrgica EVO	Autoclavable Case for EVO Surgical Guide Kit	Estuche Autoclavable para Kit Guia Quirúrgica EVO
20.402	Guia Cirúrgica 3.3mm Espaçador 1.7mm	Surgical Guide 3.3 Spacer 1.7mm	Guia Quirúrgica 3.3mm Espacio 1.7mm
20.403	Guia Cirúrgica 3.3mm Espaçador 2.0mm	Surgical Guide 3.3 Spacer 2.0mm	Guia Quirúrgica 3.3mm Espacio 2.0mm
20.404	Guia Cirúrgica 3.3mm Espaçador 3.0mm	Surgical Guide 3.3 Spacer 3.0mm	Guia Quirúrgica 3.3mm Espacio 3.0mm
20.405	Guia Cirúrgica 4.1mm Espaçador 2.0mm	Surgical Guide 4.1 Spacer 2.0mm	Guia Quirúrgica 4.1mm Espacio 2.0mm
20.406	Guia Cirúrgica 4.1mm Espaçador 3.0mm	Surgical Guide 4.1 Spacer 3.0mm	Guia Quirúrgica 4.1mm Espacio 3.0mm
20.407	Guia Cirúrgica 5.0mm Espaçador 2.0mm	Surgical Guide 5.0 Spacer 2.0mm	Guia Quirúrgica 5.0mm Espacio 2.0mm
20.408	Guia Cirúrgica 5.0mm Espaçador 3.0mm	Surgical Guide 5.0 Spacer 3.0mm	Guia Quirúrgica 5.0mm Espacio 3.0mm
20.409	Guia Cirúrgica 4.1-5.0mm Espaçador 3.0mm	Surgical Guide 4.1-5.0 Spacer 3.0mm	Guia Quirúrgica 4.1-5.0mm Espacio 3.0mm
20.411	Chave de Guia Cirúrgica	Surgical Guide Holder	Llave para Guía Quirúrgica
20.412	Bandeirinha de Guia de Posicionamento de Implantes	Surgical Guide Implant Positioning Flag	Banderita de Guía de Posicionamiento de Implantes
20.413	Pino Paralelizador	Parallel Pin	Clavija de paralelismo



GUIA CIRÚRGICA SURGICAL GUIDE · GUÍA QUIRÚRGICA

- . Determina o ponto de colocação de implantes ao lado de dentes naturais e a sequência dos próximos implantes em paralelismo ou triangulação.

. Determines the perfect location to install dental implants next to natural teeth and for the placing of the next implants - whether in parallel or triangular.

. Determina el punto de colocacion de implantes al lado de dientes naturales y la secuencia de los proximos implantes - paralelos o en triangulación.

	1.7mm	2.0mm	3.0mm		2.0mm	3.0mm
3.3mm	20.402	20.403	20.404	5.0mm	20.407	20.408
4.1mm		20.405	20.406	4.1-5.0mm		20.409



BANDEIRINHA DE GUIA SURGICAL GUIDE · BANDERITA DE GUÍA

- . Determina espaços ideais entre implantes para planejar as seguintes perfurações.

. Determine ideal spaces between implants.

. Determina espacios ideales entre implantes.

20.412



PINO PARALELIZADOR PARALLEL PIN · CLAVIJA DE PARALELISMO

- . Auxilia na utilização de bandeirinha de guia, mantendo as placas guias cirúrgicas em posição.

. Helps fix the surgical guides in position.

. Ayuda a fijar la banderita de guía, al mantener las placas quirúrgicas en posición.

20.413



CHAVE DE GUIA CIRÚRGICA SURGICAL GUIDE HOLDER · LLAVE PARA GUÍA QUIRÚRGICA

- . Para adaptação e manipulação das guias.

. To hold and use surgical guides.


. Para adaptación y manejo de las guías quirúrgicas

20.411




PLATAFORMA HE 3.3MM PALATFOM HE 3.3MM . PLATAFORMA HE

SISTEMA **Integra**® | 3.25MM SISTEMA **Duo**® | 3.8MM SISTEMA **ARES**® | 3.8MM

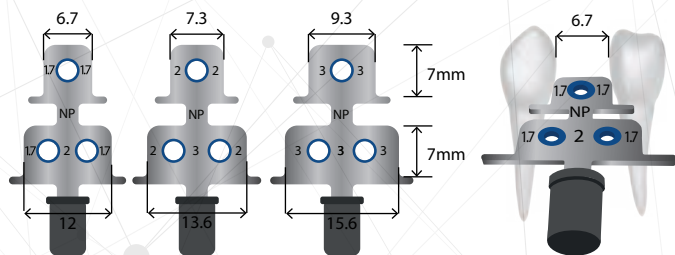

PLATAFORMA HE 4.1MM PALATFOM HE 4.1MM . PLATAFORMA HE 4.1MM


SISTEMA **Integra**® | 3.75MM + 4.0MM SISTEMA **Duo**® | 4.6MM SISTEMA **ARES**® | 4.6MM

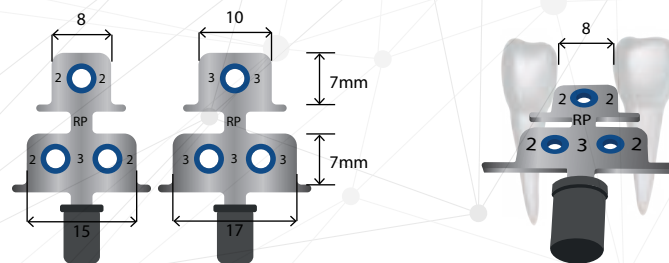

PLATAFORMA HE 4.1MM E 5.0MM


PALATFOM HE 4.1MM AND 5.0MM . PLATAFORMA HE 4.1MM Y 5.0MM

SISTEMA **Integra**® | 3.75MM + 4.0MM | 5.0MM SISTEMA **Duo**® | 4.6MM | 5.5MM

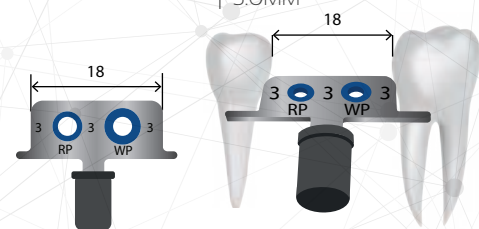


PLATAFORMA HE 5.0MM PALATFOM HE 5.0MM . PLATAFORMA HE 5.0MM

SISTEMA **Integra**® | 5.0MM SISTEMA **Duo**® | 5.5MM

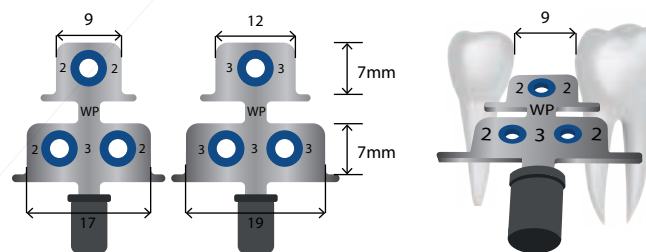

GUIA CIRÚRGICA


SURGICAL GUIDE · GUÍA QUIRÚRGICA

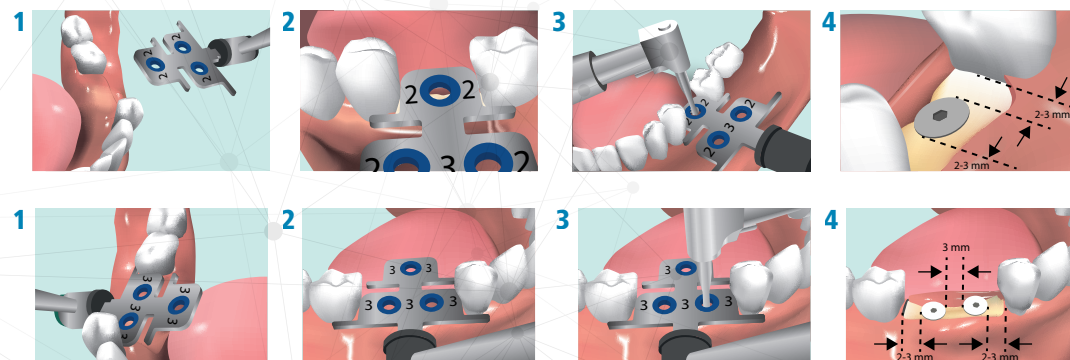

PINO PARALELIZADOR + BANDEIRINHA DE GUIA

PARALELL PIN + SURGICAL GUIDE

CLAVIJA DE PARALELISMO + BANDERITA DE GUÍA

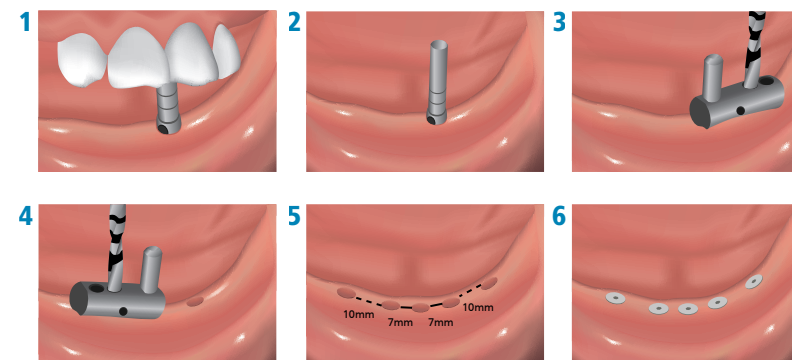

KIT ENXERTO ÓSSEO | ANCORAGEM ORTODÔNTICA

Personalize seus Kits: Selecione as peças de acordo com a sua necessidade.

Customize your Kit: Select the equipment according to your needs. | Personalice su Kit: Seleccione las piezas de acuerdo con su necesidad.

KIT ENXERTO ÓSSEO - FENDA CRUZADA (30 PARAFUSOS)

BONE GRAFTING KIT - HEAD CROSS (30 SCREWS) · KIT INJERTO ÓSEO - GRIETA CRUZADA (30 TORNILLOS)

20.505	Kit Enxerto Ósseo EVO - Fenda Cruzada	EVO Bone Grafting Kit - Head Cross	Kit Injerto Óseo EVO - Grieta Cruzada
20.555	Estojo Autoclavável para Kit de Enxerto/Ancoragem EVO	Autoclavable Case for EVO Bone Graftin/Anchorage	Estuche Autoclavable para Kit Injeto/Aclaje EVO
16.102	Broca Cirúrgica 1.1x16mm	Surgical Drill 1.1x16mm	Fresa Quirúrgica 1.1x16mm
16.103	Broca Cirúrgica 1.6x16mm	Surgical Drill 1.6x16mm	Fresa Quirúrgica 1.6x16mm
16.301	Chave Manual Compacta para Maxilo Facial	Compact Manual Maxillo-Facial Drill	Llave Manual Compacta para Maxilofacial
15.211	Haste de Inserção Parafuso de Enxerto Fenda Cruzada	Stem Insertion Screw Head Cross	Varilla de Inserción Tornillo de Injeto Grieta Cruzada
16.602	Parafuso Standard Fenda Cruzada 1.5x5.0mm	Standard Screw Head Cross 1.5x5.0mm	Tornillo Estandar Grieta Cruzada 1.5x5.0mm
16.604	Parafuso Standard Fenda Cruzada 1.5x7.0mm	Standard Screw Head Cross 1.5x7.0mm	Tornillo Estandar Grieta Cruzada 1.5x7.0mm
16.605	Parafuso Standard Fenda Cruzada 1.5x9.0mm	Standard Screw Head Cross 1.5x9.0mm	Tornillo Estandar Grieta Cruzada 1.5x9.0mm
16.606	Parafuso Standard Fenda Cruzada 1.5x11.0mm	Standard Screw Head Cross 1.5x11.0mm	Tornillo Estandar Grieta Cruzada 1.5x11.0mm
16.607	Parafuso Standard Fenda Cruzada 1.5x13.0mm	Standard Screw Head Cross 1.5x13.0mm	Tornillo Estandar Grieta Cruzada 1.5x13.0mm
16.130	Parafuso de Fixação 1.8x5.0mm Fenda Cruzada (emergência)	Fixation Graft Screw 1.8x5.0mm Head Cross (emergency)	Tornillo de Fijación 1.8x5.0mm Grieta Cruzada (emergencia)
16.131	Parafuso de Fixação 1.8x7.0mm Fenda Cruzada (emergência)	Fixation Graft Screw 1.8x7.0mm Head Cross (emergency)	Tornillo de Fijación 1.8x7.0mm Grieta Cruzada (emergencia)
16.132	Parafuso de Fixação 1.8x9.0mm Fenda Cruzada (emergência)	Fixation Graft Screw 1.8x9.0mm Head Cross (emergency)	Tornillo de Fijación 1.8x9.0mm Grieta Cruzada (emergencia)
16.133	Parafuso de Fixação 1.8x11.0mm Fenda Cruzada (emergência)	Fixation Graft Screw 1.8x11.0mm Head Cross (emergency)	Tornillo de Fijación 1.8x11.0mm Grieta Cruzada (emergencia)
16.134	Parafuso de Fixação 1.8x13.0mm Fenda Cruzada (emergência)	Fixation Graft Screw 1.8x13.0mm Head Cross (emergency)	Tornillo de Fijación 1.8x13.0mm Grieta Cruzada (emergencia)

- Estojo autoclavável;
- Completa linha de ferramentas e parafusos para fixação de enxertos ósseos em bloco, fixação de mini placas, de malhas de titânio e de membranas para a regeneração óssea.

- Autoclavable case;
- Complete line of tools and screws for fixation of bone grafts in block, setting mini plates, titanium mesh and membranes for bone regeneration

- Estuche autoclavable;
- Completa línea de herramientas y tornillos para fijación de injertos óseos en bloque, fijación de mini placas de titanio, mallas de titanio y de membranas para la regeneración ósea.



KIT ANCORAGEM ORTODÔNTICA

ORTHODONTIC ANCHORAGE KIT · KIT DE ANCLAJE ORTODÔNTICA

20.507	Kit Ancoragem Ortodôntica EVO	EVO Orthodontic Anchorage Kit	Kit Anclaje Ortodôntica EVO
20.555	Estojo Autoclavável para Kit de Enxerto/Ancoragem EVO	Autoclavable Case for EVO Bone Graftin/Anchorage	Estuche Autoclavable para Kit Injeto/Aclaje EVO
16.301	Chave Manual Compacta para Maxilo Facial	Compact Manual Maxillo-Facial Drill	Llave Manual Compacta para Maxilofacial
16.255	Broca Lança Manual	Manual Point Drill	Fresa Lanceolada Manual
16.509	Haste para Parafuso de Ancoragem Ortodôntica	Stem for Orthodontic Anchorage Screw	Varilla para Tornillos de Anclaje Ortodôntico
16.501	Parafuso de Ancoragem Ortodôntica 1.4x6.0mm	Orthodontic Anchorage Screw 1.4x6.0mm	Tornillos de Anclaje Ortodôntico 1.4x6.0mm
16.502	Parafuso de Ancoragem Ortodôntica 1.4x8.0mm	Orthodontic Anchorage Screw 1.4x8.0mm	Tornillos de Anclaje Ortodôntico 1.4x8.0mm
16.503	Parafuso de Ancoragem Ortodôntica 1.4x10.0mm	Orthodontic Anchorage Screw 1.4x10.0mm	Tornillos de Anclaje Ortodôntico 1.4x10.0mm
16.504	Parafuso de Ancoragem Ortodôntica 1.4x12.0mm	Orthodontic Anchorage Screw 1.4x12.0mm	Tornillos de Anclaje Ortodôntico 1.4x12.0mm
16.505	Parafuso de Ancoragem Ortodôntica 1.6x6.0mm	Orthodontic Anchorage Screw 1.6x6.0mm	Tornillos de Anclaje Ortodôntico 1.6x6.0mm
16.506	Parafuso de Ancoragem Ortodôntica 1.6x8.0mm	Orthodontic Anchorage Screw 1.6x8.0mm	Tornillos de Anclaje Ortodôntico 1.6x8.0mm
16.507	Parafuso de Ancoragem Ortodôntica 1.6x10.0mm	Orthodontic Anchorage Screw 1.6x10.0mm	Tornillos de Anclaje Ortodôntico 1.6x10.0mm
16.508	Parafuso de Ancoragem Ortodôntica 1.6x12.0mm	Orthodontic Anchorage Screw 1.6x12.0mm	Tornillos de Anclaje Ortodôntico 1.6x12.0mm

- Estojo autoclavável;
- Completa linha de ferramentas para instalação de implantes para ancoragem ortodôntica.

- Autoclavable case;
- Complete line of tools for installation implants for orthodontic anchorage.

- Estuche autoclavable;
- Completa línea de herramientas para instalación de implantes para anclaje ortodôntico.

PARAFUSO DE ENXERTO SCREW GRAFT · TORNILLO DE INJERTO



1.5x5.0mm	16.602
1.5x7.0mm	16.604
1.5x9.0mm	16.605
1.5x11mm	16.606
1.5x13mm	16.607

1.8x5.00mm	16.130
1.8x7.00mm	16.131
1.8x9.00mm	16.132
1.8x11.00mm	16.133
1.8x13.00mm	16.134

BROCA CIRÚRGICA SURGICAL DRILL · FRESA QUIRÚRGICA

. Comprimento: curta 60mm | longa 110mm.

. Length: short 60mm | long 110 mm.

. Largo: corta 60mm | largo 110 mm.

	Curto Short Corto	Longo Long Largo
1.1x16mm	16.102	16.113
1.6x16mm	16.103	16.114



HASTE DE INSERÇÃO PARAFUSO DE ENXERTO FENDA CRUZADA

STEM INSERTION SCREW HEAD CROSS

VARILLA DE INSERCIÓN TORNILLO DE INJERTO GRIETA CRUZADA

15.211



CHAVE MANUAL COMPACTA PARA MAXILO FACIAL

COMPACT MANUAL MAXILLO-FACIAL DRILL

LLAVE MANUAL COMPACTA PARA MAXILOFACIAL

16.301



PARAFUSO DE ANCORAGEM ORTODÓNTICA

ORTHODONTIC ANCHORAGE SCREW · TORNILLOS DE ANCLAJE ORTODÓNTICO




1.4x6.0mm	16.501
1.4x8.0mm	16.502
1.4x10.0mm	16.503
1.4x12.0mm	16.504

1.64x6.0mm	16.505
1.6x8.0mm	16.506
1.6x10.0mm	16.507
1.6x12.0mm	16.508

BROCA LANÇA MANUAL

MANUAL POINT DRILL · FRESA LANCEOLADA MANUAL

16.255

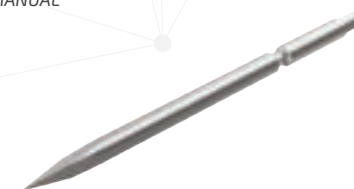

HASTE PARA PARAFUSO DE ANCORAGEM ORTODÓNTICA

STEM FOR ORTHODONTIC ANCHORAGE SCREW · VARILLA DE TORNILLO DE ANCLAJE ORTODÓNTICO

16.509



KIT PROTÉTICO PROSTHETIC KIT . KIT PROTÉSICO

- . Estojo autoclavável;
- . Para implantes cilíndricos e cônicos de hexágono externo;
- . Linha completa de chaves, conexões e torquímetro.

- . Autoclavable case;
- . For cylindrical and conical external hexagon implants;
- . Complete line of drivers, connectors and torque wrench.

- . Estuche autoclavable;
- . Para implantes cilíndricos y cónicos de hexágono externo;
- . Línea completa de llaves, conexiones y torquímetro.



20.503	Kit Protético EVO	EVO Prosthetic Kit	Kit Protésico EVO
20.553	Estojo Autoclavável para Kit Protético EVO	Autoclavable Case for EVO Prosthetic Kit	Estuche Autoclavable para Kit Protésico EVO
15.206	Chave Bidigital Adaptadora para Torquímetro	Bidigital Driver for Torque Wrench Drivers	Llave Digital para Llaves de Torquímetro
15.219	Chave Bidigital Adaptadora para Torquímetro Curta	Bidigital Driver for Torque Wrench Drivers Short	Llave Digital para Llaves de Torquímetro Corto
15.110	Chave Para Torquímetro Sextavada 0.9mm	Hex Torque Wrench Driver 0.9mm	Llave para Torquímetro Sextavada 0.9mm
15.112	Chave Para Torquímetro Sextavada 1.2mm Curta	Hex Torque Wrench Driver 1.2mm Short	Llave para Torquímetro Sextavada 1.2mm Corto
15.111	Chave Para Torquímetro Sextavada 1.2mm Media	Hex Torque Wrench Driver 1.2mm Medium	Llave para Torquímetro Sextavada 0.9mm Mediana
15.138	Chave Para Torquímetro Sextavada 1.2mm Longa	Hex Torque Wrench Driver 1.2mm Long	Llave para Torquímetro Sextavada 1.2mm Larga
15.113	Chave Para Torquímetro Quadrada 1.3mm	Square Torque Wrench Driver 1.3mm	Llave para Torquímetro Cuadrada 1.3mm
15.207	Chave Para Torquímetro Sextavada 2.0mm para O'Ring/pilar Cônico/mini Pilar Cônico	Hex Torque Wrench Driver 2.0mm for O'Ring Conical Abutment / Mini Conical Abutment	Llave para Torquímetro Sextavada 2.0mm para O'Ring Pilar Cônico / Mini
20.301	Torquímetro Protético	Prosthetic Torque Wrench	Torquímetro Protésico
15.114	Chave para Torquímetro Fenda		

Personalize seus Kits: Selecione as peças de acordo com a sua necessidade.

Customize your Kit: Select the equipment according to your needs. |

Personalice su Kit: Seleccione las piezas de acuerdo con su necesidad.

CHAVES DRIVER · LLAVES



CHAVE DIGITAL DIGITAL DRIVER · LLAVE DIGITAL

	0.9mm	1.2mm	1.3mm	
Curto Short Corto	15.101	15.103	15.108	15.106
Média Medium Mediana	15.102	15.104	15.109	15.107
Longo Long Larga	15.116	15.105	15.118	15.117

BIDIGITAL ADAPTADORA PARA CHAVES DE TORQUÍMETRO

BIDIGITAL DRIVER FOR TORQUE WRENCH
DRIVER LLAVE DIGITAL PARA LLAVES DE TORQUÍMETRO



Curto Short Corto	15.219	Longo Long Larga	15.208
Média Medium Mediana	15.206		

CHAVE PARA TORQUÍMETRO

TORQUE WRENCH DRIVER · LLAVE PARA TORQUÍMETRO



	0.9mm	1.2mm	1.3mm	
Curto Short Corto		15.112		
Média Medium Mediana	15.110	15.111	15.113	15.114
Longo Long Larga	15.137	15.138	15.139	15.140

CHAVE PARA RETÍFICA

RECTIFICATION DRIVER · LLAVE DE RETIFICACIÓN



RETIFICADORA DE ROSCA

SCREW RECTIFIER
RECTIFICADOR DE ROSCA

M 1.6	15.212	M 2.0	15.214
M 1.8	15.213	M 2.5	15.215


O'RING, MINI PILAR E PILAR CÔNICO

O'RING, MINI CONICAL AND CONICAL ABUTMENT
O'RING, MINI PILAR Y PILAR CÓNICO



2.0mm 15.207


TORQUES TORQUES · TORQUES



0.9mm 1.2mm 2.0mm

CM compact, duocon & infra

mini pilar cônico mini conical abutment · mini pilar cónico		15N.cm
munhão abutment pilar · munhão	15N.cm	
overdenture o'ring o'ring abutment · overdenture o'ring		15N.cm
pilar cônico conical abutment · pilar cónico		15N.cm
tapa implante implant cover screw · tapa implante	10N.cm	
ucla ucla abutment · ucla	15N.cm	



0.9mm 1.2mm 2.0mm

HE duo, integra & ares

coping conical abutment coping · coping		10N.cm
micro ucla micro ucla · micro ucla		15N.cm
mini pilar cônico mini conical abutment · mini pilar cónico		30N.cm
munhão abutment pilar · munhão	30N.cm	
overdenture o'ring o'ring abutment · overdenture o'ring		30N.cm
tapa implante implant cover screw · tapa implante	10N.cm	
pilar cônico conical abutment · pilar cónico		30N.cm
ucla ucla abutment · ucla	30N.cm	

KIT EXPANSORES ÓSSEOS BONE EXPANDER KIT · KIT DE EXPANSIÓN ÓSEA

- . Estojo autoclavável;
- . Kit básico com instrumentais necessários para diversas técnicas de expansão óssea lateral, separação de corticais ósseas e elevação atraumática de seio maxilar.

. Autoclavable case;
 . Basic surgical kit for different split crest expansions and atraumatic sinus lift.

. Estuche autoclavable;
 . Kit básico de instrumentos para distintas técnicas de expansión ósea y elevación del seno maxilar.

20.200	Kit Expansores Ósseo	Bone Expander Kit	Kit de Expansión Ósea
26.029	Caixa Autoclavável para Kit Expansores Ósseo	Autoclavable Case for Bone Expander Kit	Estuche Autoclavable para Kit Expansores Oseo
15.113	Chave para Torquímetro Quadrada 1.3mm	Square Torque Wrench Driver 1.3mm	Llave para Torquímetro Cuadrada 1.3mm
15.206	Chave Bidigital para Chaves de Torquímetro	Bidigital Driver for Torque Wrench Drivers	Llave Digital para Llave de Torquímetro
20.201	Expansor Ósseo 1.0 a 2.0mm Inox para Torquímetro	Bone expander 1.0 to 2.0mm Stainless Steel for Torque Wrench	Expansor Ósseo 1.0 a 2.0mm Inox para Torquímetro
20.202	Expansor Ósseo 1.5 a 2.6mm Inox para Torquímetro	Bone expander 1.5 to 2.6mm Stainless Steel for Torque Wrench	Expansor Ósseo 1.5 a 2.6mm Inox para Torquímetro
20.203	Expansor Ósseo 2.2 a 3.2mm Inox para Torquímetro	Bone expander 2.2 to 3.2mm Stainless Steel for Torque Wrench	Expansor Ósseo 2.2 a 3.2mm Inox para Torquímetro
20.321	Elevador de Seio Maxilar 2.6 a 3.2mm Inox p/ Torq.	Maxillary Sinus Elevator 2.6 to 3.2mm Stainless Steel for TW	Elevador de Seno Maxilar 2.6 a 3.2mm Inox p/ Torq.
20.322	Elevador de Seio Maxilar 3.2 a 3.8mm Inox p/ Torq.	Maxillary Sinus Elevator 3.2 to 3.8mm Stainless Steel for TW	Elevador de Seno Maxilar 3.2 a 3.8mm Inox p/ Torq.
20.323	Elevador de Seio Maxilar 3.8 a 4.2mm Inox p/ Torq.	Maxillary Sinus Elevator 3.8 to 4.2mm Stainless Steel for TW	Elevador de Seno Maxilar 3.8 a 4.2mm Inox p/ Torq.



EXPANSOR ÓSSEO BONE EXPANDER · EXPANSOR ÓSEO

- . Possibilita expandir ou condensar o osso maxilar;
- . Separa corticais ósseas preservando o osso ao redor dos implantes.

. Expands and compacts the maxillary bone;
 . Splits cortical plates preserving bone around implants.

. Posibilita expandir o condensar el hueso maxilar;
 . Expansión de las corticales óseas para mantener hueso alrededor de los implantes.



1.0 a 2.0mm	20.201
1.5 a 2.6mm	20.202
2.2 a 3.2mm	20.203

ELEVADOR DE SEIO SINUS ELEVATOR · ELEVADOR DE SENO

- . Possibilita a preparação do alvéolo para instalação do implante em regiões de pouca altura óssea da maxila posterior.

. Enables atraumatic sinus lifting technique to install the implant in regions of short bone structure at the posterior maxilla.

. Permite la preparación del alveolo para instalación del implante en regiones de poca altura ósea del seno maxilar posterior.



2.6 a 3.2mm	20.321
3.2 a 3.8mm	20.322
3.8 a 4.2mm	20.323

CHAVE PARA TORQUÍMETRO TORQUE WRENCH DRIVER · LLAVE PARA TORQUÍMETRO

- . Para aplicar o torque controlado através do torquímetro em parafusos protéticos.

. To apply the ideal torque to prosthetic screws.

. Para aplicar el torque ideal a los tornillos protésicos.



1.3mm	15.113
-------	--------

BIDIGITAL PARA CHAVES DE TORQUÍMETRO

BIDIGITAL DRIVER FOR TORQUE WRENCH DRIVERS
 LLAVE DIGITAL PARA LLAVES DE TORQUÍMETRO



15.206

TRAVA PARA EXPANSORES DE ROSCA

LOCK FOR EXPANDER SCREW
 TRABA PARA EXPANSORES DE ROSCA



2.6mm	20.211
3.2mm	20.212
3.8mm	20.213

KIT REMOÇÃO DE IMPLANTE IMPLANT REMOVAL KIT · KIT DE REMOCIÓN DEL IMPLANTE



- Estojo autoclavável em alumínio anodizado.
- Kit completo de ferramentas para remoção de implante e parafusos fraturados.

· *Autoclavable anodized aluminium case.*
 · *Complete toolkit for removal of fractured implants and screws.*

· *Estuche autoclavable en aluminio anodizado.*
 · *Kit completo de herramientas para remoción de implante y tornillos fracturados.*

20.320	Kit de Remoção de Implante	Implant Removal Kit	Kit de Remoción del Implante
20.370	Caixa Autoclavável de Remoção de Implante	Autoclavable Case for Implant Removal Kit	Estuche Autoclavable para Kit de Remoción del Implante
15.217	Extrator de Implantes	Extractor Implant	Extractor de Implante
15.218	Extrator de Parafuso Protetico	Prosthetic Extractor Screws	Extractor de Tornillo Protésico
15.408	Guia de Broca de Remoção de Parafuso para Implante HE	Guide Drill to Remove Screws for External Hex Implants	Guia de Broca de Remoción de Tornillo para Implante HE
15.409	Guia de Broca de Remoção de Parafuso Duocon 3.8mm	Guide Drill to Remove Screws for Duocon 3.8mm Implants	Guia de Broca de Remoción de Tornillo Duocon 3.8mm
15.410	Guia de Broca de Remoção de Parafuso Duocon 4.6/5.5mm	Guide Drill to Remove Screws for Duocon 4.6/5.5mm Implants	Guia de Broca de Remoción de Tornillo Duocon 4.6/5.5mm
16.260	Broca de Remoção de Parafuso Protetico	Drill Removal for Prosthetic Screw	Broca de Remoción de Tornillo Protésico
16.261	Broca Trefina 3.3mm	Trephine Drill 3.3mm	Broca Trefina 3.3mm
16.262	Broca Trefina 4.1mm	Trephine Drill 4.1mm	Broca Trefina 4.1mm
16.263	Broca Trefina 5.0mm	Trephine Drill 5.0mm	Broca Trefina 5.0mm
16.264	Broca Trefina 5.5mm	Trephine Drill 5.5mm	Broca Trefina 5.5mm
20.411	Chave de Guia Cirúrgica	Surgical Guide Holder	Llave para Guia Quirúrgica

EXTRATOR DE IMPLANTES EXTRACTOR IMPLANT · EXTRACTOR DE IMPLANTE

- Permite a remoção através do movimento anti-rotacional conjugado com pressão sobre o implante.
- Obs.: O sucesso desta técnica depende do grau de fixação do implante ao osso.

· *Allows to remove, through the anti-rotational motion conjunction with the pressure over the implant.*
 Note: The success of this technique depends on the degree of fixation of the implant to the bone.

· *Permite la remoción por medio del movimiento anti-rotacional conjugado con presión sobre el implante.*

Nota: El éxito de esta técnica depende del grado de fijación del implante al hueso.

15.217



EXTRATOR DE PARAFUSO PROTÉTICO PROSTHETIC EXTRACTOR SCREWS · EXTRACTOR DE TORNILLO PROTÉSICO

- Remove o parafuso protético fraturado dentro do implante.
- A guia e a broca de remoção preparam um furo guiado de Ø1.0mm para receber o extrator de parafusos.
- Obs.: O broca tem corte apenas no sentido anti-rotacional para favorecer a remoção do parafuso.

· *Remove the fractured prosthetic screw within the implant.*
 · The guide and the removal drill, prepare a guide hole Ø1.0mm to receive the extractor of the screws.
 Note: The drill has cut only in the anti-rotational way, to facilitate the screw removal

· *Remueve el tornillo protésico fracturado dentro del implante.*
 · La guía y la broca de remoción preparan un agujero guiado de Ø1.0mm para recibir el extractor de tornillos.
 Nota: La broca tiene corte apenas en el sentido anti-rotacional para favorecer la remoción del tornillo.

15.218



GUIA DE BROCA GUIDE DRILL · GUIA DE BROCA

- Determina o ponto central de perfuração.
- Define the central drilling point.
- Determina el punto central de perforación.

NP RP	15.408
---------	--------

NC	15.409
RC	15.410



BROCA DE REMOÇÃO DRILL REMOVAL · BROCA DE REMOCIÓN

- Faz a perfuração de Ø1.0mm para receber o extrator de parafusos.
- Utilizado em **sentido anti-horário**, com irrigação, perfuração de 3.0 à 3.5mm e velocidade do motor de 500 a 800 rpm.

· *Drill a guided hole Ø1.0mm to receive the extractor of the screws.*
 · To be used in anti-clockwise, with irrigation and drilling 3.0 to 3.5mm with engine speed: 500 to 800 rpm.

· *Hace la perforación de Ø1.0mm para recibir el extractor de tornillos.*
 · Utilizado en sentido anti-horario, con riego, perforación de 3.0 a 3.5mm y velocidad del motor de 500 a 800 rpm.

16.260




Sentido anti-horário

BROCA TREFINA TREPINE DRILL · BROCA TREFINA

- Para perfuração do leito ósseo, quando necessita de coleta de tecido ósseo ou remoção do implante instalado.

· *To drill bone site, when you need to collect bone tissue or removal the installed implant*

· *Para perforación del lecho óseo, cuando necesita de colecta de tejido óseo o remoción del implante instalado.*

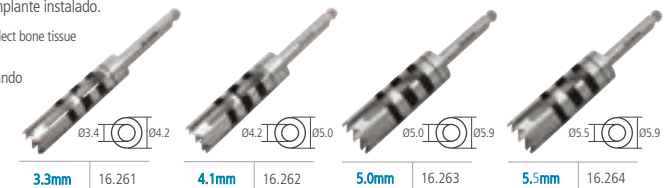

3.3mm 16.261

4.1mm 16.262

5.0mm 16.263

5.5mm 16.264

Filiais Subsidiaries | Ramas

Brasil Brazil | Brasil

BA - Salvador
Bahiafix (71) 3015-7658
(71) 3351-4640 | (71) 99257-6077
bahiafix@hotmail.com

MS - Campo Grande
Av. Campo Grande, 2207 - Centro
(67) 3044-6565 | (67) 99984-0703
marcia@signovinces.com.br

RS - Porto Alegre
R. Carlos Silveira Martins Pacheco, 10 Conj 403
Bairro Cristo Redentor
(51) 3328-1518 | (51) 98313-0059
portoalegre@signovinces.com.br

SP - São Paulo
Av. Vereador Abel Ferreira, 1800
Sala 1515, Bairro Anália Franco
(11) 2613-7656 | (11) 95978-0185
saopaulo@signovinces.com.br

SC - Florianópolis
R. General Liberato Bittencourt, 1475
Sala 508 Edifício Globo Tower
(48) 3207-4780 | (48) 99632-0146
florianopolis@signovinces.com.br

Filiais Subsidiaries | Ramas

Internacional International | Internacional

Lisboa | Portugal
Tel +351 217 975 655
Cel + 351 935 014 972
europa.pt@signovinces.com.br

Contato Internacional

International Contact | Contacto Internacional

PR - Campo Largo
Tel +55 41 3052-7673
Cel + 55 41 99928-0174
internacional@signovinces.com.br